

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszkielce.pl



Kielce, dnia 22.06.2017r.

EZ/ZP/56/2017/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych urządzeń medycznych dla potrzeb WSzZ w Kielcach, znak sprawy EZ/ZP/56/2017/EK.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Dotyczy:

Załącznik nr 2d

Sufitowa lampa bezcieniowa – 2 szt. PAKIET NR 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę zabiegową w której wymiary czaszy wynoszą 230x330mm i kształt jak poniżej?

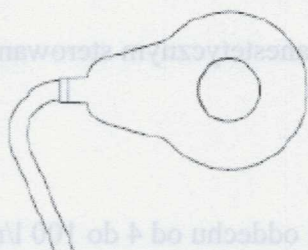

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę zabiegową nie posiadającą uchwytów brudnych w której pozycjonowanie odbywa się za pomocą uchwytu sterylnego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 3


Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę zabiegową wyposażoną w 6 punktów świetlnych (diod LED) każdy punkt jest oddzielnym reflektorem z własnym odbłyśnikiem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę zabiegową w której średnica pola operacyjnego wynosi 17cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszkielce.pl



Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę zabiegową w której głębokość oświetlenia wynosi 120cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę zabiegową w której uchwyt sterylny przesunięty jest względem osi centralnej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną lampę zabiegową w której regulacja natężenia odbywa się za pomocą panelu umieszczonego na czaszy lampy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy:

Załącznik nr 2 f ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Aparat do znieczulenia ogólnego 1 szt. - PAKIET NR 3

Pytanie 9 Ad. pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z respiratorem anestetycznym sterowanym pneumatycznie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 10 Ad. pkt. 34.

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z reg. częstości oddechu od 4 do 100 l/min, zakresem który nieznacznie różni się od zakresu wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 11 Ad. pkt. 36.


Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie od 3 do 30 cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 12 Ad. pkt. 40.

Ze względu na to, że przepływ jest parametrem którego wartość w trybach regulowanych ciśnieniem jest uzależniona od nastawy ciśnienia ze względu na naturalną zależność wynikającą z praw fizyki, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z możliwością regulacji czasu narastania ciśnienia w trybach kontrolowanych ciśnieniem i z ciśnieniem wspomagania ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszkielce.pl



Pytanie 13 Ad. pkt. 50.

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z obrazowaniem oddechów wyzwalanych przez pacjenta poprzez zaznaczenie ich innym kolorem na krzywej ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 14 Ad. pkt. 59.

Ze względu na posiadaniem funkcji optymalnego doboru przepływu świeżego gazu, która określa zapotrzebowanie pacjenta na tlen, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z trendami podatności, bez trendów MV*CO₂ (emisji dwutlenku węgla)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 15 Ad. pkt. 62.

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania prezentacją na panelu przednim ciśnienia zasilania awaryjnego z butli?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 Ad. pkt. 63.

Ze względu na konieczność sprawdzenia i dostosowania ustawień wentylacji do pacjenta zwracamy się z pytaniem Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z doбором parametrów wentylacji na podstawie kategorii wiekowej pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 17 Ad. pkt. 65.

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z wyświetlaniem C_{pat} na ekranie respiratora oraz funkcją zapisywania pętli referencyjnej, bez możliwości rozbudowy o pobór O₂?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Monitor anestezjologiczny

Pytanie 18 Ad. pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze jednostki nieznacznie większej od wymaganej i wynoszącej 7,5 kg, który spełnia pozostałe wymogi postawione w pkt. 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 19 Ad. pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści monitor z wbudowanym zasilaczem?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 20 Ad. pkt. 25.

Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem saturacji producenta monitora?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Warunki ogólne, dokumentacja

Pytanie 21 Ad. pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści dokumentację techniczną sprzętu w języku angielskim?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ



Pytanie 22 Ad. pkt. 3.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dokumentacji technicznej? Urządzenia medyczne powinny być naprawiane i podlegać konserwacji przez odpowiednio przeszkolony personel.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 23

Zamawiający w pkt. 13 b SIWZ wskazuje, iż Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) musi wskazać dodatkowy termin gwarancji. Prosimy o wskazanie miejsca w formularzu ofertowym, w którym wykonawca ma wpisać w/w informacje.

Odpowiedź: Dodatkowy okres gwarancji należy wpisać w Załączniku nr 2 do SIWZ stosowny do określonego urzędnika medycznego.

Pytanie 24 – dotyczy § 4 ust. 2-3; 5 wzoru umowy

Wnosimy o usunięcie w/w zapisów, tak aby usunąć niezgodność treści wzoru umowy z obowiązującymi przepisami prawa.


Nasz wniosek opieramy na stanowisku, iż obowiązujące przepisy prawa w sposób zwięzły i ograniczony regulują obszar związany z wykonywaniem umów o zamówienie publiczne, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zaś Zamawiający uregulował we wzorze umowy kwestię podwykonawstwa, wprowadzając w jego treści zapisy adekwatne wyłącznie do umów o zamówienie publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane co, w świetle obowiązujących przepisów i bacząc na ogólnie pojęty interes obu Stron, nie powinno mieć miejsca. W związku z powyższym prosimy dostosowanie postanowień wzoru umowy do obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych.

Ustawa reguluje co prawda problematykę umów o podwykonawstwo w sprawach zamówień publicznych, ale w dużej mierze ogranicza się do regulacji związanych z problematyką podwykonawstwa **robót budowlanych**. Zakres ochrony przysługującej podwykonawcom uległ istotnemu rozszerzeniu na gruncie Ustawy w związku z objęciem przez uregulowania w zakresie umowy o podwykonawstwo nie tylko podwykonawców robót budowlanych, jak ma to miejsce na gruncie Kodeksu cywilnego, ale także podwykonawców dostaw i usług biorących udział w realizacji zamówienia publicznego realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane.

Określenie przez Zamawiającego zasad dotyczących podwykonawstwa w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga odpowiedniego ich ujęcia tak, by pozostawały w zgodzie z postanowieniami Ustawy.

W związku z powyższym, uprawnienia Zamawiającego w ramach zamówienia na dostawy, ograniczają się do możliwości żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (lub podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oraz określenia w SIWZ obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. **Pozostałe regulacje ustawowe obowiązują w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, służące do wykonania części zamówienia na roboty budowlane.**

Objęcie przepisami dotyczącymi kwestii podwykonawstwa także zamówień na dostawy nie jest uzasadnione, bowiem przedmiotem dostaw mogą być tak świadczenia skomplikowane i specjalistyczne jak i proste, a wprowadzenie dodatkowych ograniczeń odnośnie podwykonawstwa mogłoby skutkować istotnym ograniczeniem konkurencji i ograniczeniem kręgu wykonawców wyłącznie do producentów przedmiotu dostawy!



Proszę zwrócić uwagę np. na wymóg przedstawiony w § 4 ust. 3 wzoru umowy w zakresie obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia, stanowi o błędnej interpretacji przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Obowiązek, o którym mowa w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp spoczywa bowiem na wykonawcy, podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane, który będzie realizował jej część w postaci dostaw lub usług na podstawie zawartej umowy podwykonawczej. Wymóg wprowadzony przez Zamawiającego w w/w zapisie wzoru umowy nie wynika zatem ani z przepisów prawa ani z przyjętych zwyczajów. Proszę pamiętać, iż Wykonawca i tak ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez podwykonawców, którym powierzył wykonanie określonych czynności, co Zamawiający przewidział w § 4 ust. 4 wzoru umowy oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji.

Podkreślenia wymaga fakt, iż grudniowa nowelizacja prawa zamówień publicznych nie wnosi zmian w stosunku do relacji z podwykonawcami zamówienia na dostawy w zakresie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Nie znajdzie tu zastosowania ww. przepis art. 143b. ust. 8 ustawy Pzp, który owszem obliguje wykonawcę do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, ale wyłącznie w przypadku realizacji zamówienia na roboty budowlane. Przedmiotowe zapisy wprowadzone przez Zamawiającego stoją zatem w sprzeczności z zasadami postępowania określonymi prawem i jako takie powinny zostać wykreślone. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 25 – dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie inne koszty ma na myśli?

Uważamy, że zapis proponowany przez Zamawiającego powinien zostać zmieniony, jako niedopuszczalny na tle art. 29 ust. 1 PZP. Zgodnie z tym, jednym z naczelnych, przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych „*Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń*”. Zapisu proponowanego przez Zamawiającego w żadnym wypadku nie można uznać, ani za jednoznaczny, ani tym bardziej za dostatecznie dokładny i wyczerpujący.

Odpowiedź: „Inne koszty” niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

Pytanie 26 - dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy

Wnosimy o zmianę zapisu ww. ustępu poprzez wykreślenie warunku zapłaty Wykonawcy przysługującej mu należności w postaci konieczności przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Przed wszystkim Zamawiający nie powinien uzurpować sobie prawa do wpływania na dwustronne stosunki handlowe wykonawców z ich kontrahentami, w tym podwykonawcami uczestniczącymi przy wykonywaniu zamówienia publicznego, co czyni wprowadzając do umowy ww. postanowienie, dotyczące płatności na rzecz podwykonawców.

W tym miejscu warto przypomnieć zasady odpowiedzialności Zamawiającego za zobowiązania wykonawców wobec podwykonawców robót, które określa art. 647¹ ustawy Kodeks Cywilny, art. 143c. ust. 1 Ustawy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego (m.in. uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 roku - III CZP 36/2006, uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2008 roku - III CZP 6/08).



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszskielce.pl



Na gruncie Kodeksu Cywilnego solidarna odpowiedzialność Zamawiającego obejmuje podwykonawców wykonujących roboty budowlane, a zatem nie obejmuje dostawców materiałów i usługodawców.

W rozumieniu Ustawy, inaczej niż w przypadku umowy o roboty budowlane uregulowanej w Kodeksie Cywilnym, przepisy przewidują iluzoryczną (przez wyjątkowość zaistnienia takiego przypadku) odpowiedzialność zamawiającego za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcom nie tylko w zakresie umów o roboty budowlane, ale wszelkich umów o podwykonawstwo, czyli również tych, których przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, jeżeli zostały zawarte w ramach zamówieniach publicznego na roboty budowlane. Bezwzględny warunkiem solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawców jest przy tym przedstawienie zamawiającemu do zatwierdzenia umów podwykonawczych. Biorąc pod uwagę, iż przedmiotem zamówienia jest w tym przypadku dostawa sprzętu medycznego, nie znajdują tu zastosowania przepisy prawa dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców. Mając na uwadze powyższe argumenty, w/w postanowienia wzoru umowy należy uznać za dalece wykraczające poza regulacje ustawowe i jako niezgodne z prawem - bezskuteczne.

Ponownie podkreślamy, iż solidarna odpowiedzialność zamawiającego za zobowiązania wykonawców wobec podwykonawców określona w art. 143c. ust. 1 Ustawy, oznacza owszem odpowiedzialność zamawiającego za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcom nie tylko w zakresie umów o roboty budowlane, ale wszelkich umów o podwykonawstwo, czyli również tych, których przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, **jednakże tylko w przypadku, gdy zostały one zawarte w ramach zamówieniach publicznego na roboty budowlane!**

Biorąc pod uwagę, iż przedmiotem zamówienia jest w tym przypadku dostawa sprzętu medycznego, nie znajdują tu zastosowania przepisy prawa dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców, w tym także art. 143c. ust 7 Ustawy.

Wprowadzając przywołane wyżej zapisy we wzorze umowy dla Postępowania Zamawiający przyjmuje na siebie rygor odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania wobec podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wykonujących część zamówienia publicznego, mimo iż Ustawodawca na niego takiej odpowiedzialności nie nakłada. To powoduje po jego stronie wzrost ryzyka i kosztów, a ponadto nastęrcza dodatkowej pracy, chociażby poprzez konieczność weryfikacji umów z podwykonawcami, badania zasadności roszczeń o zapłatę należnego im wynagrodzenia itp.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ


Pytanie 27 – dotyczy §6 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do powyższego zapisu następującego zdania: „Zmiana stawki VAT powodują zmianę ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 28 – dotyczy §7 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący „ W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem, pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do jej rozpatrzenia w terminie 5 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 15 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji.”?



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 29 - dotyczy § 7 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o dokonanie modyfikacji w/w zapisu tak, aby powstał zapis:

„3. Okres gwarancji danej części (elementu, podzespołu) sprzętu składającego się na przedmiot umowy każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy tej wadliwej części (elementu, podzespołu) sprzętu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia.”

Przedłużenie okresu gwarancji na cały asortyment, którego dostawa stanowi przedmiot umowy, w przypadku naprawy gwarancyjnej jakiegokolwiek jego części (elementu, podzespołu), nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechną praktyką postępowania w takim przypadku jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, regulującymi kwestie dotyczące gwarancji jakości przy sprzedaży, objęcie dodatkowym okresem gwarancji jedynie naprawianej części (elementu, podzespołu).

Przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności danej części (elementu, podzespołu) sprzętu na cały sprzęt, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, związanych z przedłużeniem gwarancji na całość sprzętu, co skutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 30 – dotyczy §7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu ze wzoru umowy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 31 – dotyczy §8 ust. 3 pkt. 2 lit. c wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do w/w zapisu następującego zdania: „przy czym dostarczenie urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach w terminie, o którym mowa w §7 ust. 2 jest traktowane jako wykonanie umowy w terminie i za okres jego używania Zamawiającemu nie przysługują uprawnienia do kar umownych z tytułu §8 ust. 1 pkt. 2 lit. c”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ



Pytanie 33 – dotyczy §8 ust. 3 pkt. 2 lit a wzoru umowy

Wnosimy o zmianę w/w zapisu na następujący: „za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1”?

Pozostawienie w/w zapisu bez zmian narusza zasadę równości stron, gdyż kary płacone przez Zamawiającego, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego wynoszą 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 34 - dotyczy §8 ust. 3 pkt. 2 lit b wzoru umowy

Wnosimy o zmianę w/w zapisu na następujący: „za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,2% wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”?

Powyższe kary umowne są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionej korzyści dla Zamawiającego. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 35 - dotyczy §8 ust. 3 pkt. 2 lit c wzoru umowy

Wnosimy o zmianę w/w zapisu na następujący: „za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rekójmi – 0,2% wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”?

Powyższe kary umowne są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionej korzyści dla Zamawiającego. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 36 – dotyczy §8 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 37– dotyczy §9 ust.8 pkt. 1 lit c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do w/w zapisu następującego zdania: „po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania obowiązków umownych i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu, dodatkowego terminu, nie krótszego niż 15 dni”?



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 38 – dotyczy §9 ust. 8 pkt. 1 lit d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „Wykonawca trzykrotnie został zasadnie ukarany w wyniku trzykrotnego naruszenia tożsamyh obowiązków określonych w umowie”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy treści SIWZ:

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie LAMP BEZCIENIOWYCH (2SZT.) z pakietu nr 2 do oddzielnego zadania? Znacznie zwiększy to konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 2d – Lampa bezcieniowa (2szt.)

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową, której obudowa oraz uchwyt brudny wykonane są z lekkiego tworzywa ABS z dodatkowym elementem odprowadzającym ciepło wykonanym z aluminium? Oferowane tworzywo jest bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne i gwarantuje łatwe czyszczenie i dezynfekcję.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową, której oprawa wyposażona jest w matrycę diodową złożoną z 20 punktów LED?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową, której oprawa wyposażona jest w matrycę diodową złożoną z 30 punktów LED?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową ze średnicą pola operacyjnego d10 wynoszącą 195mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o wgłębności oświetlenia L1/L2 przy 60% oświetlenia na poziomie 970mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o mocy maksymalnej: 30W?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszkielce.pl



Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w wymienny uchwyt przystosowany do sterylizacji umieszczony z boku czaszy w miejscu niezaburzającym wiązki światła? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o temperaturze barwowej na poziomie 4500°K?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 48

Dotyczy pakiet nr 2:

Poz. 4

Czy Zamawiający będzie wymagał aby oprawa lampy od strony reflektora wyposażona była w szybę ochronną wykonaną z wysokiej jakości szkła bezpiecznego. Zastosowanie tego typu materiału gwarantuje stałą, wysoką przezierność oraz eliminuje efekt "starzenia" matowienia – jak to ma miejsce w przypadku stosowania osłon tworzywowych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści lampę o konstrukcji czaszy w kształcie wieloboku, spełniającą wszelkie normy pracy w przepływie laminarnym, nie zakłócając jego przebiegu ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w maksymalnie 3 brudne uchwyty okalające czaszę w min. 3/4 jej obwodu ? Konstrukcja uchwytów umożliwia łatwy dostęp personelu dbającego o prawidłową dezynfekcję oraz czystość lampy, do całej jej powierzchni.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51

Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę, której oprawa wyposażona jest w matrycę diodową złożoną z 18 wysokowydajnych diod LED zapewniających natężenie oświetlenia na poziomie 60 000 Lux / 1 m ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 52

Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której średnica pola operacyjnego wynosi 17 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53

Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści lampę z oprawą o głębokości oświetlenia L1 / L2 na poziomie 1530 mm przy 20 % oświetlenia ?

Parametr oferowany tylko nieznacznie różni się od wymaganego i nie będzie stanowił istotnej różnicy dla operatora w trakcie wykonywania zabiegu.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszkielce.pl



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54

Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści lampę z oprawą wyposażoną w umieszczony przy niej uchwyt sterylny, umożliwiający regulację natężenia światła ?

Przy oprawach o małych rozmiarach, jakie są stosowane w przypadku lamp zabiegowych, montowanie uchwyty sterylnego centralnie, w osi symetrii czaszy może mieć negatywny wpływ na stożek świetlny, zakłócając w ten sposób jednorodność pola bezcieniowego co przekłada się na niższą jakość oświetlanego w polu operacyjnym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55

Poz. 18. Czy Zamawiający będzie wymagał oprawy o współczynniku odwzorowania barw na poziomie min. 96 ? Parametr ten na poziomie 96 % jest obecnie powszechnie oferowany przez czołowych producentów lamp operacyjnych/zabiegowych. Różnica kilku procent z pozoru może wydawać się nieznaczająca lecz efekt jest dość wyraźny i ma korzystny wpływ na decyzyjność operatora w trakcie przeprowadzania zabiegu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 56

Poz. 19. Czy Zamawiający będzie wymagał oprawy o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej na poziomie min. 96 ?

Parametr ten na poziomie 96 % jest obecnie powszechnie oferowany przez czołowych producentów lamp operacyjnych/zabiegowych. Różnica kilku procent z pozoru może wydawać się nieznaczająca lecz efekt jest dość wyraźny (rozróżnialność tkanek poprzez zwiększenie wyrazistości barwy czerwonej) i ma korzystny wpływ na decyzyjność operatora w trakcie przeprowadzania zabiegu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57

Poz. 20. Czy Zamawiający będzie wymagał oprawy o temperaturze barwowej światła na poziomie 4500 K ? Parametr na tym poziomie gwarantuje realistyczne odwzorowanie kolorów ponieważ idealnie imituje temperaturę światła naturalnego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 58


Poz. 22. Czy Zamawiający dopuści oprawę z regulacją natężenia światła w zakresie 25000 – 60000 Lux, z uchwytem sterylnym umiejscowionym przy oprawie ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 59

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje urządzenia RAD-97 SET fabrycznie nowego czy demonstracyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017 r.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszkielce.pl



Pytanie nr 60

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez rotacji ekranu w technologii Nellcor Oximax?
Zapis o technologii Masimo wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr w technologii Nellcor Oximax – pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji oparty na fali tętna? Zapis: „Masimo SET” wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez możliwości rozbudowy o pomiar meth-, karboksy-, hemoglobiny całkowitej? Zapis o możliwości rozbudowy wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 63

W związku z użyciem zastrzeżonych znaków towarowych Masimo, prosimy o objaśnienie wymaganych w tabeli funkcji RRA oraz PVI w języku polskim lub trzymając się zapisu skrótów w języku angielskim. Zapis z użyciem znaków towarowych nie wyjaśnia czego oczekuje Zamawiający oraz wskazuje na jednego producenta. Wszelkie zapisy zawierające znaki towarowe, nazwy handlowe powinny być opatrzone zapisem „typ”, „typu” i mieć krótkie wyjaśnienie funkcjonalności.

Odpowiedź: Funkcja pomiaru RRA - po angielsku Acoustic Respiration Rate– pomiar ilości oddechów mierzony w sposób akustyczny, PVI – po angielsku Pleth Variability Index – indeks zmienności krzywej pletyzmograficznej.

Pytanie nr 64

Co Zamawiający ma na myśli pod zapisem: „pulsoksymetr prezentujący czułość”?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli widoczny stale na ekranie tryb wyboru czułości pomiaru (do wyboru przez użytkownika) – normal, max lub APOD

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wskaźnikiem perfuzji 8-segmentowym zamiast cyfrowego? Pokazuje tętno oraz względną amplitudę tętna (bez normalizacji). Przy zwiększaniu wykrywanego tętna, z każdym uderzeniem serca zostanie wyświetlona większa liczba pasków. W przypadku braku perfuzji obwodowej pulsoksymetr umożliwia pomiar za pomocą czujników naczolowych dla pacjentów powyżej 10 kg.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ


Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, którego zasilanie z akumulatora wynosi 5 h przy czasie pełnego naładowania 4h?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o 240 g. cięższy?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269 -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszkielce.pl



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o zakresie saturacji 1-100?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o dokładności częstości tętna +/-5 cyfr w ruchu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wygodnym pokrętelem nawigacyjnym po ekranie LCD bez regulacji kontrastu, podświetlania wyświetlacza zamiast ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający dopuści widoczne ikony trybu pacjenta w jednolitym kolorze? Czy jednolity kolor ikon pokazujący graficzny obraz noworodka, dziecko, dorosłego z sybolem przy grafice nie będzie wystarczający do wybrania trybu pacjenta? Opisywanie kodowania kolorów trybów wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z funkcją przywołania pielęgniarki i portem USB, bez WIFI, Ethernet, oraz Bluetooth?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający zauważy różnicę przy analizie trendów zapisów gdy pulsoksymetr będzie wyświetlał je z rozdzielczością co 4s. w normalnych warunkach monitorowania?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z rozdzielczością co 4 s.?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 75

W związku z wymaganą rozdzielczością, czy Zamawiający oczekuje by w warunkach alarmowych rozdzielczość zwiększała się do 1 s.?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, który wymaga podchodzenia do pacjenta i śledzenia zmian wartości saturacji przy przekraczaniu granic alarmowych sygnalizowanych dźwiękowo i graficznie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszkielce.pl



Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru perfuzji 0,03% - 20%?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 78

Prosimy o wyjaśnienie zakresów NORM, MAX i APOD, które są znakami towarowymi Masimo. Zamawiający ma obowiązek opisać parametry w taki sposób, by Oferenci mogli ocenić czy spełniają zapisane wymagania. Zapis z użyciem znaków towarowych nie wyjaśnia czego oczekuje Zamawiający oraz wskazuje na jednego producenta. Wszelkie zapisy zawierające znaki towarowe, nazwy handlowe powinny być opatrzone zapisem „typ”, „typu” i mieć krótkie wyjaśnienie funkcjonalności. Użycie wyżej wymienionych symboli wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź: Możliwość pomiaru w trzech trybach czułości do wyboru przez użytkownika, gdzie NORM to tryb pracy w czułości tzw. Standardowej, MAX – tryb pracy w czułości przestawionej na czułość Maksymalną, APOD – tryb pracy w czułości dedykowanej w warunkach szczególnie narażonych na odłączenie czujnika i w sytuacjach kiedy pacjenci nie są w sposób ciągły monitorowani wizualnie.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o dwóch trybach odpowiedzi, uśredniania: normalny - w ciągu 5 do 7 s. oraz szybki - od 2 do 4 s. w sytuacjach ścisłego monitorowania?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez menu w języku polskim?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, którego czas na baterii akumulatorowej wynosi 7 godzin, ale przy najmniejszej jasności wyświetlacza i bez włączonej transmisji bezprzewodowej?


Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 82

Zamawiający wymaga w p. 72 jednoczesnego zaoferowania wszystkich opcji komunikacji w pulsoksymetrze:

- Port USB
- port przywołania pielęgniarki
- WiFi
- Bluetooth
- Ethernet

Funkcjonalność urządzenia polegająca na transmisji danych z pulsoksymetru może być



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-517
zamowienia@wszkielce.pl



realizowana na różne sposoby, ale zwykle jednocześnie tylko w jeden sposób uzasadniony funkcjonującym systemem informatycznym w szpitalu. Najbardziej uniwersalnym portem jest port USB, który umożliwia przesyłanie danych do sieci szpitalnej lub np.: pamięci FLASH. Port przywołania pielęgniarki jest wykorzystywany głównie na terenie USA i zupełnie nieobecny w naszym Systemie ochrony zdrowia. Opisany w p.16 wymóg zaoferowania jednocześnie wszystkich portów jest kalką opisu technicznego pulsoksymetru MassimoSET RAD-97 i jedynym aparatem na rynku który spełnia ten wymóg. Uprzejmie prosimy o nieograniczanie konkurencji i umożliwienie innym producentom realizację wymogu funkcjonalności pulsoksymetru polegającego na transmisji danych tylko poprzez najbardziej uniwersalny port USB lub zmianę wymogu na nieobligatoryjny (punktowany); w przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o uzasadnienie faktyczne jakie systemy w szpitalu będą zbierały sygnały cyfrowe z Pulsoksymetrów (z szczególnym wskazaniem charakterystyki odbiorników WiFi i Bluetooth).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 72. Zamawiający dopuszcza komunikację wyłącznie za pomocą portu USB.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Andrzej Domański

