

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”

Kielce ...09.10.2019...

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” w ramach działania 7.3 oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

znak sprawy: EZ/ZP/106/20109/EK

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet nr 1

Zadanie nr 1 - Kolumna anestezjologiczna z windą na aparat do znieczulania – 1 kpl

Pytanie 1 Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z ramieniem łamanym wykonanym z profili aluminiowych, o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osiach łożysk równym 2130mm w tym pierwsze ramię sztywne o długości 1130mm i drugie uchylne o długości 1000mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w elektropneumatyczne hamulce obrotu osi?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 3 Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę w której oznaczenie odpowiednich hamulców na przegubach jest w postaci grafiki w odpowiednim kolorze korespondującej z przyciskami sterującymi blokadami bez dodatkowych diod?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 4 Punkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w gniazda wyrównania potencjałów w ilości 16szt?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą wyposażoną w szyny montażowe umieszczone wewnątrz każdej ściany głowicy dające możliwość samodzielnego montażu bez użycia



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

narzędzi wszystkich akcesoriów na czterech stronach głowicy oraz uniwersalnego uchwytu do podnoszenia wózków i aparatów do znieczulenia dedykowanego do oferowanego typu kolumny?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2 - Kolumna chirurgiczna – 1 szt.

Pytanie 6 Punkt 39

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w elektropneumatyczne hamulce obrotu osi?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 7 Punkt 41

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę w której oznaczenie odpowiednich hamulców na przegubach jest w postaci grafiki w odpowiednim kolorze korespondującej z przyciskami sterującymi blokadami bez dodatkowych diod?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 8 Punkt 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w gniazda wyrównania potencjałów w ilości 16szt?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Punkt 45

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą wyposażoną w szyny montażowe umieszczone wewnątrz każdej ściany głowicy dające możliwość samodzielnego montażu bez użycia narzędzi wszystkich akcesoriów na czterech stronach głowicy oraz uniwersalnego uchwytu do podnoszenia wózków i aparatów do znieczulenia dedykowanego do oferowanego typu kolumny?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3 - Lampa operacyjna dwuczaszowa z wysięgnikiem pod monitory oraz kamerą medyczną HD – 1 kpl

Pytanie 10 Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której dolna powierzchnia czasz zabezpieczona jest szybą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się w sposób elektroniczny tylko za pomocą panelu umieszczonego przy czaszy lampy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 Punkt 9 i 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której czasie lamp zbudowane są z dwóch bloków o kształcie trapezu razem dając sześciokąt foremny? Konstrukcja lamp zapewnia bardzo dobre parametry cyrkulacji powietrza nie wpływając na pracę nawiewu laminarnego oraz nie stwarza problemów podczas czyszczenia i dezynfekcji ponadto unikalny sposób zawieszenia czaszy na ramieniu daje nam możliwość bez wysiłkowego manewrowania czaszą.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”

Pytanie 13 Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której zakres regulacji wielkości plamy świetlnej d10 z 1m dla każdej czaszy wynosi 16 – 23 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 Punkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia wynosi 94cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 15 Punkt 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której moc pobierana przez matrycę LED wynosi 65VA dla maksymalnych możliwych ustawień parametrów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1 - Kolumna anestezjologiczna z windą na aparat do znieczulania

Pytanie 16

Dot. pkt. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z ramieniem łamanym o zasięgu 1900 mm, co nieznacznie różni się od zasięgu wymaganego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Dot. pkt. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z dolnym ramieniem pozwalającym na podnoszenie i opuszczanie głowicy zasilającej na wysokość 50 cm, co nieznacznie różni się od parametru wymaganego i nie ma znaczącego wpływu na użytkowanie kolumny.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 18

Dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną z hamulcami pneumatycznymi sterowane zaworami elektromagnetycznymi, których skuteczność niczym nie różni się od hamulców elektromagnetycznych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Dot. pkt. 28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z głowicą wyposażoną w podwójne szyny typu „M” montowane pionowo o znacznie większej nośności niż szyny o przekroju prostokątnym 25x10 mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości od posadzki do stropu oraz jeśli występuje strop podwieszany wysokości od posadzki do powierzchni zewnętrznej sufitu podwieszanego w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana kolumna.

Odpowiedź: Wysokość Sali 4,95m, strop podwieszany jest na wys. 3,00 m od posadzek, odległość między sufitem podwieszanym a stropem 1,95 m.

Pytanie 21

Prosimy Zamawiającego o informację, czy nośność stropu, do którego będzie podwieszana kolumna jest wystarczająca. Jeśli nie, to czy Zamawiający na własny koszt i odpowiedzialność dokona odpowiedniego wzmocnienia stropów?

Odpowiedź: Tak, nośność stropu przewiduje montaż kolumn.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Pytanie 22

Czy Zamawiający na własny koszt doprowadzi do punktów montażu kolumny wszystkie niezbędne media tj. wszystkie rurociągi gazów medycznych, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz dokona ich prawidłowego oznaczenia?

Odpowiedź: Tak Zamawiający doprowadzi na własny koszt niezbędne media.

Zadanie nr 2 - Kolumna chirurgiczna

Pytanie 23

Dot. pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezyjologiczną z hamulcami pneumatycznymi sterowane zaworami elektromagnetycznymi, których skuteczność niczym nie różni się od hamulców elektromagnetycznych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Dot. pkt. 45. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z głowicą wyposażoną w podwójne szyny typu „M” montowane pionowo o znacznie większej nośności niż szyny o przekroju prostokątnym 25x10 mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Dot. pkt. 49. Czy Zamawiający może określić podstawowe wymiary zewnętrzne wózka, który ma być zawieszany na głowicy kolumny chirurgicznej?

Odpowiedź: Podstawowe wymiary zewnętrzne wózka to: wysokość 1200 mm, głębokość 490 mm, szerokość 500mm.

Pytanie 26

Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości od posadzki do stropu oraz jeśli występuje strop podwieszany wysokości od posadzki do powierzchni zewnętrznej sufitu podwieszanego w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana kolumna.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 20.

Pytanie 27

Prosimy Zamawiającego o informację, czy nośność stropu, do którego będzie podwieszana kolumna jest wystarczająca. Jeśli nie, to czy Zamawiający na własny koszt i odpowiedzialność dokona odpowiedniego wzmocnienia stropów?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 21.

Pytanie 28

Czy Zamawiający na własny koszt doprowadzi do punktów montażu kolumny wszystkie niezbędne media tj. wszystkie rurociągi gazów medycznych, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz dokona ich prawidłowego oznaczenia?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 22.

DOTYCZY PAKIETU NR 1 – PROJEKT UMOWY ORAZ SIWZ

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w zakresie pakietu nr 1 postanowienie zawarte w § 1 ust. 2 projektu umowy zostanie usunięte na etapie podpisania umowy. Kolumny anestezyjologiczne oraz lampy nie wymagają instalacji oprogramowania oraz udzielenia licencji. Utrzymanie tego postanowienia w zakresie asortymentu z pakietu nr 1 jest zatem bezprzedmiotowe.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie zawarcia umowy zmodyfikuje odpowiednio treść § 1 ust. 2 projektu umowy, iż nie dotyczy urządzeń wskazanych w Pakiecie nr 1.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że instalacji, uruchomienie i przeszkolenie personelu (obowiązek zawarty w § 1 ust. 5 projektu umowy) zostaną przeprowadzone w tym samym dniu. Rozbicie realizacji tych obowiązków na odrębne terminy może doprowadzić do bezzasadnego zawyżenia oferowanej ceny. Uprzejmie prosimy o zawarcie w projekcie umowy stosownego postanowienia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy” zawartego w § 5 ust. 3 projektu umowy bądź wykreślenie tego postanowienia? Użyte pojęcie jest bardzo nieostre i uniemożliwia Wykonawcy rzetelne przygotowanie oferty. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji umowy powinny być w niej wyszczególnione.

Odpowiedź: Jako „inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy” Zamawiający rozumie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, które nie są wprost wymienione w SIWZ, a zgodnie z technologią i następstwem prac montażowo – rozruchowych są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Pytanie 32

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową z 7 dni do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy (§ 7 ust. 2 projektu umowy). Oferowany towar jest sprowadzany z zagranicy, co znacząco wydłuża termin realizacji obowiązków gwarancyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/projekcie umowy/załącznikach do SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z postanowienia zawartego w § 7 ust. 5 projektu umowy. Kolumny anestezyjologiczne są sprzętem sprowadzonym z zagranicy pod konkretne, indywidualne zamówienie. Nie ma zatem możliwości, aby Wykonawca dysponował tego typu sprzętem zastępczym. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/projekcie umowy/załącznikach do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie zawarcia umowy zmodyfikuje odpowiednio treść § 7 ust. 5 projektu umowy, iż nie dotyczy urządzeń wskazanych w Pakiecie nr 1.

Pytanie 34

Prosimy Zamawiającego zmniejszenie wysokości przewidzianych kar umownych:

- w § 8 ust. 2 lit. a) – z 20% do 10% wynagrodzenia brutto;
- w § 8 ust. 2 lit. b) – z 5000 zł do 0,2% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie;
- w § 8 ust. 2 lit. c) – z 500 zł do 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, braków lub niezgodności towaru z umową za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane. Powszechnie przyjmuje się, że kary umowne są zryczałtowaną formą odszkodowania i pełnią funkcję kompensacyjną, a zatem nie powinny prowadzić do bezzasadnego wzbogacenia jednego kontrahenta kosztem drugiego. Tak wysokie kary umowne przeczą funkcji kompensacyjnej i stanowią przejaw wykorzystania pozycji dominującej Zamawiającego. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 10% wartości brutto wynagrodzenia w przypadku umownego prawa odstąpienia (przy czym należy zwrócić uwagę, że wysokość kar umownych zarówno po stronie wykonawcy jak i zamawiającego powinna być tożsama, albowiem jest to przejaw zasady równości stron stosunku zobowiązaniowego) oraz na poziomie 0,1-0,2% wartości brutto za niezrealizowaną część zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków umownych. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/projekcie umowy/załącznikach do SIWZ.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu przewidzianego w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. c) z 5 dni kalendarzowych do 10 dni kalendarzowych. Zastrzeżenie możliwości skorzystania z umownego prawa odstąpienia w przypadku zwłoki w realizacji postanowień umownych już zaledwie o 5 dni kalendarzowych jest przejawem wykorzystania pozycji dominującej Zamawiającego, albowiem wiąże się z przerzuceniem ryzyka powodzenia transakcji handlowej w całości na Wykonawcę. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/projekcie umowy/załącznikach do SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1

Zadanie nr 3 – Lampa operacyjna dwuczaszowa z wysięgnikiem pod monitory oraz kamerą medyczną HD – 1 kpl


Pytanie 36

Ad. 1. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której wszystkie ramiona zamontowane są współosiowo? Jest to rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Ad. 1 i 31. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie każdy monitor zamontowany jest na osobnym ramieniu, jak na poniższym rysunku?

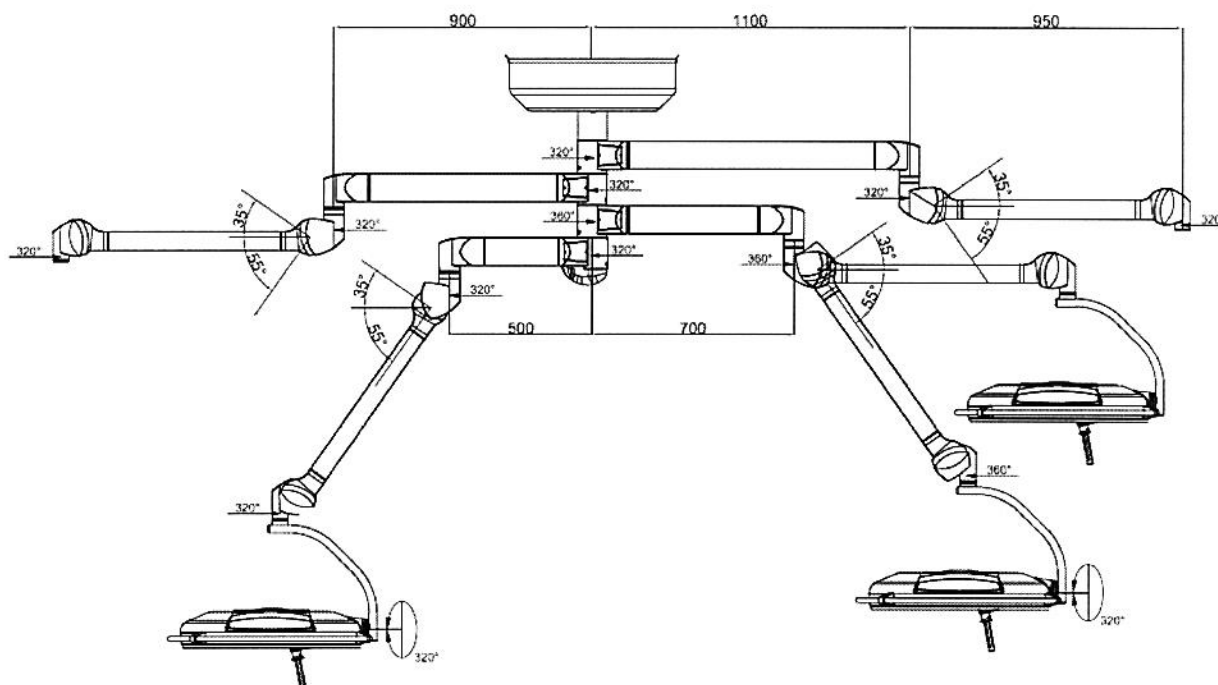

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”

Pytanie 38

Ad. 2. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną której kopuła wyposażona jest w 110 diod LED o kolorystyce białej? Większa ilość diod zapewnia wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz bardziej jednorodną plamę świetlną, jednocześnie nie powoduje wzrostu poboru mocy, która wynosi dla kopuły 50W

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Ad.2. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której matryca diodowa składa się z diod białych emitujących światło białe w trzech różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne”, białe „ciepłe”, białe neutralne)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymieniane są moduły świetlne? Wymiany dokonuje autoryzowany serwis. Jako producent lamp operacyjnych z wieloletnim doświadczeniem uważamy, że ze względów bezpieczeństwa, osoby nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia nie powinny ingerować w strukturę lampy. Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści funkcję regulacji średnicy pola bezcieniowego tylko za pomocą wymiennego uchwyty? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację natężenia światła w zakresie 25 - 100%, realizowaną przy pomocy dwóch sterowników umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach – elektroniczna regulacja odbywa się w 10 stopniach?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 43

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę ze światłem endoskopowym w kolorze zielonym? Jest to długość fali, bardziej przyjazna dla oka ludzkiego, przy kolorze zielonym wzrok szybciej się regeneruje. Poza tym kolor światła Endo nie ma wpływu na funkcjonalność lampy operacyjnej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z oświetleniem endoskopowym zintegrowanym z czaszą, umieszczone w górnej jej części przez co światło jest skierowane w górę (sufit) przy standardowym ustawieniu czaszy względem pola operacyjnego? Możliwość ustawienia oświetlenia w dowolnym kierunku, także w kierunku pola operacyjnego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Ad.8. Czy Zamawiający dopuści kopuły o średnicy 63 cm? Oferowane czasze zapewniają dużą bezcieniowość, są lekkie i łatwe w manewrowaniu. Jest to rozwiązanie równoważne do żądanego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Pytanie 46

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której kopuły wyposażone są dodatkowo w niesterylizowany uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopułą lampy? Zapewnia on wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie na uchwycie, co umożliwi pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza 75 % obwodu kopuły.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 47

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści regulowaną temperaturę barwową w przedziale 4000 – 4800 K? Daje to możliwość większego komfortu pracy, ponieważ umożliwia ustawienie temperatury barwowej pod wymogi konkretnego operatora.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści lampę o regulowanej średnicy pola bezcieniowego w zakresie 190-360mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 49

Ad. 21. Kamera. Czy Zamawiający dopuści kamerę o poniższych parametrach:

Zasilanie	24V DC
pobór mocy	3,4W
powiększenie optyczne	10x, f=3.8 mm to 38 mm (F 1.8 to F3.4)
powiększenie cyfrowe	12x
rozdzielczość	1920x1080i/50 (Full HD, przepłot).
ogniskowanie	Automatyczne
balans bieli	Automatyczny
kąt obiektywu	7,6-67 stopni
minimalna jasność	0,35 lux (rekomendowana 100lux)
minimalna odległość pracy	10mm (800mm dla oddalenia)
migawka elektroniczna	od 1s do 1/10000s
wyjście sygnału Video	HD-SDI, 3G-SDI (cyfrowe)
parametry przewodu dla sygnału Video	koncentr. 75Ohm o paśmie min. 3GHz
złącze sygnału Video	BNC (75 Ohm)
Obrót	350°

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

Ad. 35. Czy Zamawiający dopuści lampę o poborze mocy 50 W dla każdej czaszy? Jest to wartość niewielka przy tak dużej liczbie diod.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Pytanie 51

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odpowiedź: Strop żelbetowy wylewany.

Pytanie 52

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: Wysokość Sali 4,95m, strop podwieszany jest na wys. 3,00 m od posadzek, odległość między sufitem podwieszanym a stropem 1,95 m.

Pytanie 53

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź: UPS centralny na budynek Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na 400V + agregat prądotwórczy 650 KWA.

Pytanie 54

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub-stropowych elementów montażowych.

Odpowiedź: Nie, jest to ostatnia kondygnacja budynku.

Pytanie 55

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź: Tak, jest to nowa inwestycja wyposażona w instalację zasilającą i będą wyprowadzone zgodnie z projektem w miejscu montażu lampy.

Pytanie 56

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55.

Pytanie 57

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta

Odpowiedź: Nie.

PAKIET NR 2

Zadanie nr 5 – MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY – 5 szt.


Pytanie 58

– **Pyt. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji ” **MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY** ” z **Pakietu 2** na rzecz oddzielnego **Pakietu** w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższającą technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urzędzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

– **Pkt. 1** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z liczbą 17 komór o wysokości 20,3 cm, wykonanych z PU z zaawansowaną komorą powietrzną zamiast podkładu piankowego ?



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60

– Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o rozmiarze 198 x 86 x 20,3 cm ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61

– Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez obniżonej sekcji pięt ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62

– Pkt. 12/13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z automatycznym dopasowaniem ciśnienia do wagi pacjenta oraz manualną możliwością regulacji w zakresie od 30 do 60 mmHg ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63

– Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z 3 trybami pracy: zmiennociśnieniowym, statycznym oraz maksymalnego napełnienia komór ?

Odpowiedź: Tak ,dopuszcza się.

Pytanie 64

– Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez dodatkowego przycisku wywołującego funkcję siedziska ? Oferowany materac automatycznie dopasowuje się do pozycji pacjenta, w tym do siedzenia.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 65

– Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą wolną od wibracji charakteryzująca się bardzo cichą pracą do 30 dbA ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

– Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą o wadze 3,4 kg ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 67

– Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z pompą odporną na zalanie na poziomie IPX1 ? Odporność na zalania jest na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, tylko poziom przenikania cząstek jest inny.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68

– Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez oznaczeń na komorach czy pokrowcu materaca ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”

Pytanie 69

– **Pkt. 28** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwoleżynowy bez dodatkowych klinów ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1/ Zadanie nr 3 – Lampa operacyjna dwuczasaowa z wysięgnikiem pod monitory oraz kamera medyczną HD – 1 szt.

Pytanie 70

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000°K w 5 krokach? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze gdyż również zagwarantuje białe światło w polu operacyjnym z dodatkową możliwością regulacji temperatury barwowej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z obiema czaszami ze źródłem światła w technologii diodowej z 90 diodami LED?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszami z możliwością wymiany zespołów diod składających się z 15 diod?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której matryce LED osłonięte są łatwą do czyszczenia, jednorodną osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania? Pod względem użytkowym będzie to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez możliwości regulacji natężenia światła za pomocą uchwytu sterylnego, jednakże z możliwością regulacji natężenia z dwóch niezależnych miejsc tj. za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego z boku czaszy oraz za pomocą bezprzewodowego sterownika montowanego na ścianie lub kolumnie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze światłem endoskopowym włączanym z poziomu panelu sterowania po wciśnięciu dwufunkcyjnego przycisku odpowiedzialnego za obniżenie natężenia światła?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 76

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy czasz wynoszącej 63cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”

Pytanie 77

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barw każdej czaszy na poziomie $CRI \geq 95$ przy zachowaniu równie wysokiego współczynnika odwzorowania barwy czerwonej na poziomie $R9 \geq 95$?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla każdej czaszy w zakresie od 200 do 420mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której czasza główna **fabrycznie będzie wyposażona** we wbudowaną, przewodową kamerę HD przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego – kamera (cała wraz z obiektywem) zintegrowana niecentralnie w czaszy za szybką ochronną (brak elementów kamery wystających poza obrys kopuły), a więc bez możliwości obrotu i pochylecia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 80

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z mocą pobieraną przez matrycę LED każdej czaszy na poziomie 48W?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dot. Zadanie nr 1 – Kolumna anestezjologiczna

Pakiet 81

Czy Zamawiający dopuści półkę o wymiarach całkowitych 63 cm x 43 cm co *nieznacznie różni* się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dot. Zadanie nr 2 – Kolumna chirurgiczna

Pakiet 82

Czy Zamawiający dopuści półkę o wymiarach całkowitych 63 cm x 43 cm co *nieznacznie różni* się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dot. Zadanie nr 3 – Lampa operacyjna

Pakiet 83

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę renomowanego niemieckiego producenta o maksymalnym poborze mocy 53W dla każdej czaszy ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet 84

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną renomowanego niemieckiego producenta, której głębokość oświetlenia L1+L2 wynosi 93 cm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pakiet 85

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę renomowanego niemieckiego producenta z odrębnym przyciskiem światła endoskopowego umieszczonym na panelu sterowania z boku czaszy ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”

Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 1

Zadanie nr 1 - Kolumna anestezjologiczna z windą na aparat do znieczulania – 1 kpl

Pytanie 86 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z oznaczeniem na łożysk ramienia kolorem i figurą zgodną z przyciskami sterującymi blokadą w zamian za lampki LED?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia, z klapką ochronną o stopniu ochrony IP44 (min. dwa obwody, każdy oznaczony innym kolorem)? Pozostałe wyposażenie zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 88 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą od frontu i dodatkowo z tyłu wyposażoną w dwie wewnętrzne pionowe prowadnice o rozstawie 234 mm umożliwiające montaż adapterów do wózków z półkami i aparatów do anestezji oraz do montażu półek? Rozwiązanie z wewnętrznymi szynami znacznie ułatwia utrzymanie urządzeń w czystości co jest dużą korzyścią dla Zamawiającego, dodatkowo umożliwi mocowanie akcesoriów z dwóch stron głowicy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2 - Kolumna chirurgiczna – 1 szt

Pytanie 89 poz. 41

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z oznaczeniem na łożysk ramienia kolorem i figurą zgodną z przyciskami sterującymi blokadą w zamian za lampki LED?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90 poz. 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia, z klapką ochronną o stopniu ochrony IP44 (min. dwa obwody, każdy oznaczony innym kolorem)? Pozostałe wyposażenie zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 91 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą od frontu i dodatkowo z tyłu wyposażoną w dwie wewnętrzne pionowe prowadnice o rozstawie 234 mm umożliwiające montaż adapterów do wózków z półkami i aparatów do anestezji oraz do montażu półek? Rozwiązanie z wewnętrznymi szynami znacznie ułatwia utrzymanie urządzeń w czystości co jest dużą korzyścią dla Zamawiającego, dodatkowo umożliwi mocowanie akcesoriów z dwóch stron głowicy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3 - Lampa operacyjna dwuczaszowa z wysięgnikiem pod monitory oraz kamerą medyczną HD – 1 kpl.

Lampa operacyjna dwuczaszowa z wysięgnikiem pod monitory oraz kamerą medyczną HD

a) Czasza na pojedynczym zawieszeniu z kamerą w osi centralnej zawieszenia.

b) Czasza oraz uchwyt na dwa monitory na podwójnym zawieszeniu.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Pytanie 92 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której obie czasze wyposażone jest w 88 diod LED o kolorystyce białej, o tej samej temperaturze barwowej? Większa ilość diod pozwala na utrzymanie lepszej bezcieniowości w polu operacyjnym o jednorodnej strukturze.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, której obie czasze mają średnicę 74 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, której każda czasza posiada kształt przedstawiony na poniższej fotografii, o figurze wpisanej w koło o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania w czystości?



Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, której obie czasze są jednorodne, bez podziału, wykonane z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła oraz w tworzywowych uchwytami i elementami zewnętrznymi amortyzującymi skutki uderzenia lampami o siebie lub o inne urządzenia na sali operacyjnej?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 96 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z temperaturą barwową równą 4350K co jest parametrem niezauważalnym dla ludzkiego oka w porównaniu do wymaganej temperatury?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97 poz. 28 i 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę wyposażoną w kamerę obrotową z możliwością jej obrotu o kąt 330°?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
PROJEKT

„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Pytanie 98 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z maksymalną mocą całej lampy równą 118W?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, wzór umowy

Pytanie 99, dotyczy § 8 pkt. 1 ppkt 2 b

Prosimy Zamawiającego o modyfikację ww. zapisów wzoru umowy w następujący sposób:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:


- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **20%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – **0,5% wartości urządzenia dostarczonego ze zwłoką**, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – **0,5% wartości towaru, którego dotyczy wada, brak lub niezgodność z umową**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.


Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

KIEROWNIK
Działu Usług Publicznych

mgr Sebastian Szemiatowski

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji i Ekonomicznych
inż. Andrzej Domanski



Z-CA DYREKTORA
ds. lecznicowa
Krzysztof H. H.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 09.10.2019 r.

PELNOMOCNICTWO

Jako jedyna osoba umocowana do reprezentacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, upoważniam:

1. w dniu 10.10.2019 r. Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa p. Krzysztofa Bidasa,
2. w dniu 11.10.2019 r. Zastępcę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa p. Wiesławę Nowocień,

- do podejmowania wszystkich czynności związanych z reprezentacją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w tym również do podpisywania pism i wszelkiego rodzaju dokumentów w imieniu podmiotu leczniczego.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Suplewski