

EZ/ZP/144/2021/KP

Kielce dn. 02.11.2021r

*Do wszystkich zainteresowanych*

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021, poz. 1129) **zakup i dostawę zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy w powiązaniu z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

**dot. Pakietu nr 2**

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

Czy elektrody do czasowej stymulacji serca z pakietu nr 2 powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?

**Odpowiedź:** Tak, elektrody bezwzględnie powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia.

**Pytanie 2**

**dot. Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca mogących zabezpieczać pacjenta do 2 tygodni?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający oczekuje elektrod mogących zabezpieczyć pacjenta do minimum 2 tygodni.

**Pytanie 3**

**dot. Pakietu nr 2**

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

**Odpowiedź:** Kardiostymulator MIP 801 oraz DIAGNOSTIM MDD-501 i RECORD.

**Pytanie 4**


**dot. Pakietu nr 2**

Czy w oparciu o normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?


**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających wymogi normy PN-EN 60601-1.

**Pytanie 5**

**dot. Pakietu nr 2**



Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego cenowo, o najwyższej jakości – zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do czasowej stymulacji serca, endokawitarnych dwubiegunowych, które z powodzeniem stosowane są na wielu oddziałach kardiologii na terenie Polski i w Europie. Elektrody dostępne są w średnicach 4, 5F i 6F. Długość elektrody 120cm. Poniżej dostępne 4 krzywizny elektrod:

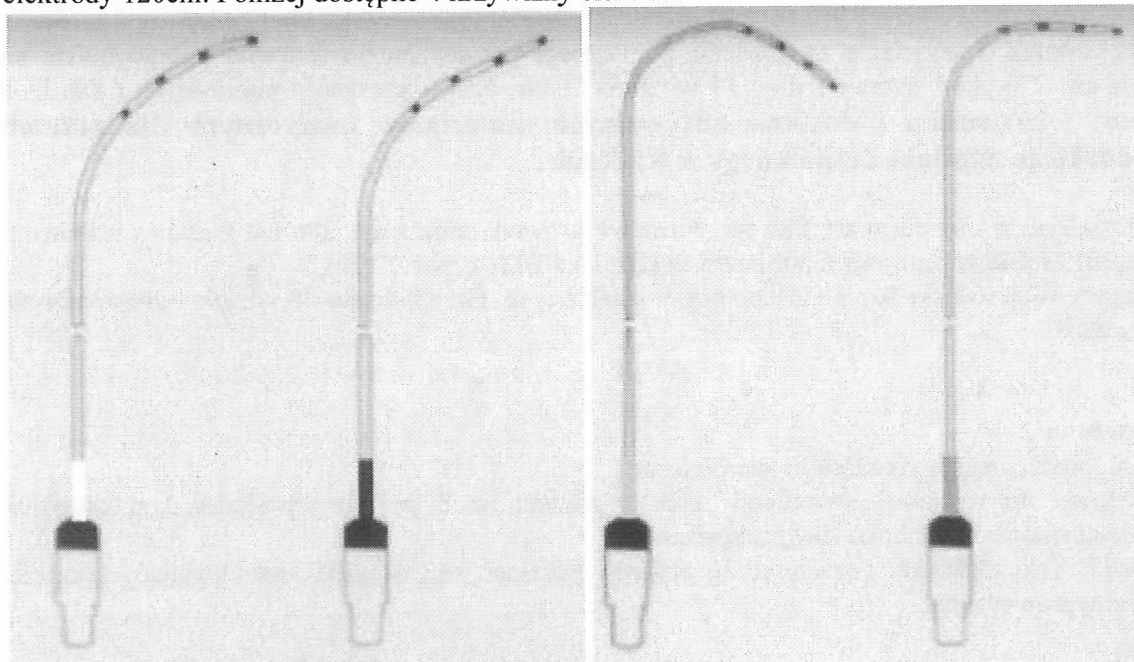

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ – kompatybilne z posiadanymi stymulatorami MIP801 oraz DIAGNOSTIM MDD-501 i RECOR D.

#### Pytanie 6

##### dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, który posiada centralną etykietę z 4 nalepkami do wklejenia do dokumentacji medycznej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 7

##### dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby serwety kompresowe w rozmiarze 80x60 cm posiadały gramaturę 50g/m<sup>2</sup>, co zapewnia dużą chłonność wyrobu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

#### Pytanie 8

##### Dot. projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający się na zmianę sposobu naliczania kar umownych na następujący sposób:

#### § 9

##### Kary umowne

- 1) Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
  - Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:



- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 10 - w wysokości 10% z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
  - za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
  - za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 500.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
  - w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 50,00 zł za stwierdzone uchybienie

**Odpowiedź:** Względem zapisów dotyczących kar umownych Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 9**

**dot. Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający w przypadku wezwania do przedłożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10**

**Dot. Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka jałowy zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11**

**Dot. Pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka jałowy z serwetkami 80 x 60 cm wykonanymi z włókniny Spunlace, zamiast kompresowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12**

**Dot. Pakietu nr 3, poz. 1**


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem 0,2 mikrona o wyższej skuteczności filtracji niż wymagana przez Zamawiającego oraz samouszczelnianicym się zaworem bezigłowym zabezpieczającym przed wyciekaniem po rozłączeniu oraz skażeniem pozostałej zawartości płynu lub leku w butelce lub fiolce

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie nr 13**

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie



wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu.

**Pytanie nr 14**

**Dot. Pakietu nr 3, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz, 2 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty w poz.1 szerszemu gronu wykonawców.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworów o poniższych parametrach:

1) Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć)i. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 16**

**Dot. Pakietu nr 4, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawory mają wywoływać neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania

**Odpowiedź:** Zamawiający nie określa parametru ciśnienia wstecznego, neutralnego lub pozytywnego. Zamawiający wymaga, aby na drenie był zamontowany zacisk ślizgowy zapobiegający cofaniu leku i płynu. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska  
inspektor

Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14  
[edyta.stefanska@wszkielce.pl](mailto:edyta.stefanska@wszkielce.pl)