



EZ/ZP/223/2022/ES

Kielce dn. 10.01.2023r

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na Zakup i dostawa zastawek, wycinaków, elektrod, konduktów, stabilizatorów i shunt dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak EZ/ZP/223/2022/ES

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (T.J.Dz.U. z 2022r poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 2

Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie zadania, prosimy o dopuszczenie również następujących parametrów wycinaków aortalnych:


- Wykonanie z materiałów nietrombogennych i apyrogennych
- Dostępne średnice: 2.5mm/2.8mm/3.6mm/4.0mm/4.4mm/4.8mm
- Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 2

dot. Pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie również następujących parametrów elektrod bipolarnych z 1 igłą przezmostkową:

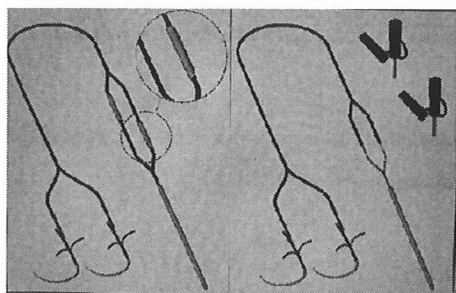

MODEL	ELEKTRODA BIPOLARNA STANDARDOWA DLA DOROSŁYCH
DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA	60cm lub 220cm
IGŁA PIERSIOWA - SKÓRNA	Igła pełna bez kanału, długość 63mm (prosta) lub 90mm (zagięta), średnica igły 0,90mm
IGŁA SERCOWA	22mm kształt 1/2 koła, średnica igły 0,51mm
ŚREDNICA PRZEWODU	0,45mm
MATERIAŁ PRZEWODZĄCY	Stal nierdzewna z konduktorem 0,20mm



IZOLOWANY PRZEWÓD	<i>Izolowany materiał typ PE</i>
KOLOR	<i>Biały i niebieski</i>
PODŁĄCZENIE DO STYMULATORA	<i>Złoty pin o średnicy 1mm o długości 16mm/ model M: konektor złoty, powłoka PVC z pinem o średnicy 2mm</i>


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 6

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego jakościowo (TERUMO) i cenowo, (oszczędność dla Szpitala na poziomie MINIMUM 65.000- 70.000 złotych netto) - prosimy o dopuszczenie RÓWNIEŻ następujących stabilizatorów tkankowych:

- Stabilizator wykonany z lekkich tworzyw sztucznych
- Mocowanie do dowolnego rozwieracza do klatki piersiowej
- Przegubowe ramię posiadające zdolność dowolnego kształtowania w każdym wymiarze, zamocowane na obrotowym zawieszisku do stopki
- Układ stabilizujący na nadany kształt ramienia (pamięć mechaniczna)
- Stopa stabilizująca fragment mięśnia sercowego wyposażona w elastyczne i ruchome przyssawki dające się regulować, atraumatyczne
- Możliwość regulacji siły ssania
- Możliwość zastosowania do tętnic wieńcowych/ w tym do ściany bocznej
- Możliwość łatwego zamontowania i demontowania ruchomej części ramienia.
- Dreny z tworzywa PCV medycznego do połączenia z układem ssącym.
- Tytanowe ramiona wielorazowego użytku dostarczone w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Zamawiającego na cały czas trwania kontraktu nieodpłatnie. UWAGA - Możliwość wymiany ramion (w ciągu maximum 2 dni roboczych w razie awarii któregoś z ramion).

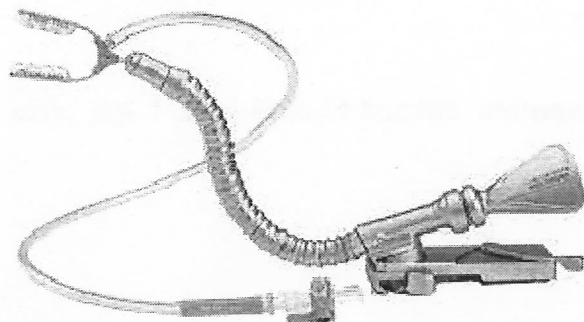

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wycinaków pakowanych po 6 sztuk?
Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 3



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elektrod kompatybilnych z urządzeniem do ablacji Medtronic ValleyLab™ FT10? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrod do generatora do ablacji firmy Medtronic CARDIOLATE 68000.

Pytanie 6

dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w Pak 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Wycinaki do aorty, dwie powierzchnie tnące, zwężony odcinek dystalny ostrza tnącego dla lepszej widoczności w okolicy zespolenia w roz. 2.8mm, 3.6mm, 4.0mm. do wyboru. 1 op = 6szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w Pak 2 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

Pytanie 8

Dot. wzoru umowy § 10 ust. 2

Prosimy o zmniejszenie maksymalnej łącznej kary umownej do 15% wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w zakresie kar umownych.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor

