

Kielce, dn. 13.09.2023

Dział Zamówień Publicznych

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy zestawów cewników naczyniowych permanentnych dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Odpowiedzi na pytania


Pytanie nr 1

Pytanie 1 Zamawiający w pakiecie 1 umieścił szczegółowy opis przedmiotu zamówienia co jest sprzeczne z założeniami o równoważności, nie uzasadnił jakie cechy powinien posiadać cewnik a skupił się wyłącznie na sztywnych parametrach technicznych, co stanowi naruszenie art99 ust 5 i 6 PZP. Mając na względzie powyższe oraz równy dostęp do zamówień publicznych prosimy o dopuszczenie cewników o tych samych lub lepszych funkcjach leczniczych, lecz niewielkich różnicach w zakresie danych technicznych:


Pozycja 1 oferujemy: cewnik o przepływach

Testy wykonane w obiegu pozaustrojowym z płynem o takiej samej lepkości (3,5 cP w temperaturze 37°C) jak krew

Tests done on extracorporeal circuit with fluid having same viscosity (3.5 cP at 37°C) of blood.

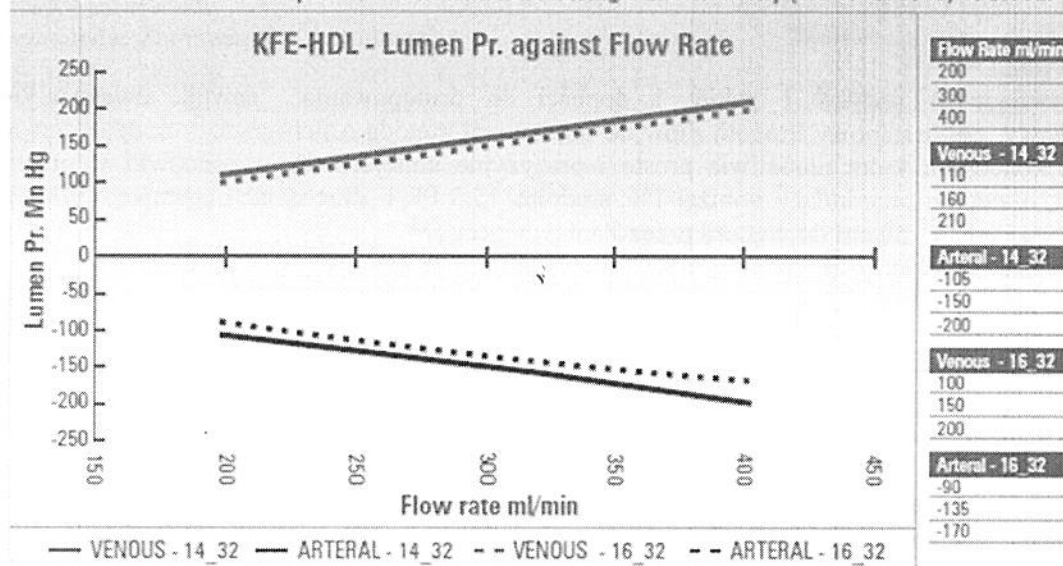

o rozmiarach: 14 Fr i dł. 19/24 cm; 23/28 cm; 27/32 cm; 31/36 cm; 35/40 cm zamiast 14,5 Fr i dł. 19/36 cm; 23/40 cm; 28/45 cm; 33/50 cm; skład zestawu: 1 x cewnik, 1 x 18g x 7cm igła introduktora z zaworem bocznym 1 x 0.035" x 70cm prowadnik nitinolowy z końcówką J, 2 x rozszerzacz naczynia, 1 x introduktor z odrywaną osłonką, 1



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



x mandryn tunelowy 1 x strzykawka 10ml, 1 x Skalpel nr 11, 2 x Nasadki iniekcyjne, 1 x Bezszywowe urządzenie mocujące 2 x Opatrunek na ranę, 1 x Naklejka identyfikacyjna pacjenta zamiast: cewnik 14,5 Fr; igła wprowadzająca grub.18G; prowadnica J-prosta 0,96 mm x 70 cm; rozrywana koszulka z zaworem / rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr z PTFE; mandryn tunelujący 21 cm; rozszerzacz tkankowy 12 Fr i 14 Fr.; strzykawka 12ml; skalpel nr 11; 4 szt. gaziki 10x10cm; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pozycja 2 oferujemy cewnik odporny na rozpuszczalniki i na wszystkie powszechnie stosowane roztwory czyszczące na bazie jodu i alkoholu, wytrzymały na rozciąganie, elastyczny, odporny na załamania - zamiast cewnik z powłoką heparynową i jonami srebra, miękki

Bez zapisu: ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo zapobiegającymi przyklejaniu się do naczyń i wykrzepianiu; rozmiary: 14 Fr i dł. 19/24 cm; 23/27 cm; 27/32 cm; 31/36 cm; 35/40 cm; do wyboru przez Zamawiającego zamiast 14,5 Fr i dł. 19/36 cm; 23/40 cm; 28/45 cm; 33/50 cm; do wyboru przez Zamawiającego.

Skład zestawu: 1 x cewnik, 1 x 18g x 7cm igła introduktora z zaworem bocznym 1 x 0.035" x 70cm prowadnik nitinolowy z końcówką J, 2 x rozszerzacz naczyń, 1 x introduktor z odrywaną osłonką, 1 x mandryn tunelowy 1 x strzykawka 10ml, 1 x Skalpel nr 11, 2 x Nasadki iniekcyjne, 1 x Bezszywowe urządzenie mocujące 2 x Opatrunek na ranę, 1 x Naklejka identyfikacyjna pacjenta zamiast: W skład zestawu wchodzi: cewnik 14,5 Fr; igła wprowadzająca grub.18G; prowadnica J prosta 0,038 cala x 70cm; rozrywana koszulka / rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr z PTFE; tuneler rozwidlony; rozszerzacz 12 Fr.; strzykawka 12ml; skalpel nr 11; gaziki 10x10cm; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 3

Pakiet nr 1 poz.1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 19/36 cm, 23/40 cm, 38/45 cm, 33/50 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- nasadki iniekcyjne Luer Lock

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kubaśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor