

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Kielce, dnia 15.02.2024 r.

Znak sprawy: EZ/18/2024/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) pn. „Zakup i dostawa wózków reanimacyjnych i defibrylatorów na potrzeby Oddziałów/Klinik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA DO PAKIETU NR 1

Pytanie 1


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wózka reanimacyjnego o poniższych parametrach:

Wózek Reanimacyjny:

- szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2x156mm),
- 2 x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1 x wieszak kroplówki,
- 1 x stelaż do worka na odpady ze zdejmowaną pokrywą z tworzywa ABS,
- 1 x pojemnik na narzędzia 325x175x40mm,
- 1 x uchwyt butli z tlenem,
- 1 x deska do RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt.,
- 1 x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu,

WYKONANIE:

- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu,
 - blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm,
 - szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik TECHMED, prowadnice szuflad z samodociągami, wyposażona w uchwyt do prowadzenia,
 - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą,
 - elementy dekoracyjne (maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu, uchwyt do prowadzenia) lakierowane proszkowo na wybrany kolor frontów szuflad,
 - uchwyt do pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 700x560x1000 mm (wysokość od podłoża do blatu)
wymiary szafki: 600x500x390 mm
wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145 mm



wymiary blatu: 600x500 mm

wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm

[szerokość x głębokość x wysokość].

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wózka reanimacyjnego z dwoma szufladami oraz z blatem z tworzywa ABS.

Pytanie 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wózka reanimacyjnego o poniższych parametrach:

Wózek Reanimacyjny:

szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2x156mm),

1 x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu,

2 x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami,

1 x wieszak kroplówki,

1 x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron,

1 x pojemnik na zużyte igły,

1 x listwa zasilająca,

1 x uchwyt butli z tlenem,

1 x deska do RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt.,

WYKONANIE:

- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu,

- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm,

- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik TECHMED, prowadnice szuflad z samodociągami, wyposażona w uchwyt do prowadzenia,

- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą,

- elementy dekoracyjne (maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu, uchwyt do prowadzenia) lakierowane proszkowo na wybrany kolor frontów szuflad,

- uchwyt do pojemnika na zużyte igły ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 700x560x1000 mm (wysokość od podłoża do blatu)

wymiary szafki: 600x500x390 mm

wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145 mm

wymiary blatu: 600x500 mm

wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm

[szerokość x głębokość x wysokość].

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wózka reanimacyjnego z dwoma szufladami oraz z blatem z tworzywa ABS.

Pytanie 3

Czy (w pkt. 2 i 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego konstrukcję (w tym ścianki boczne i tylna) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję; wyposażenie dodatkowe mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka?

Odpowiedź:



Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego konstrukcję (w tym ścianki boczne i tylna) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję, z szynami do mocowania wyposażenia dodatkowego z możliwością regulacji wysokości.

Pytanie 4

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary: szerokość 720 mm, głębokość 620 mm, wysokość 1065 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Czy (w pkt. 4 i 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat roboczy z czterema profilowanymi brzegami, z czego trzy są podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów (pojemników i sprzętu medycznego) przed upadkiem oraz zabezpieczającymi przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego górny blat roboczy wykonany z formowanego, estetycznego, antypoślizgowego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego fronty i uchwyty szuflad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie posiadającego mat antypoślizgowych w szufladach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9


Czy (w pkt. 11 i 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie posiadającego szyn do montowania wyposażenia? W oferowanym wózku wyposażenie będzie mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka (nie ma konieczności stosowania szyn do montowania wyposażenia).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego dodatkowy wysuwany blat boczny wykonany z estetycznego tworzywa sztucznego?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza blat boczny wysuwany, wykonany z aluminium, lakierowany proszkowo.

Pytanie 11

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szuflady o nośności 10 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego koła pojedyncze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wieszak kroplówki z dwoma haczykami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szuflady o wysokości (od góry): 2 szuflady 7,5 cm, 2 szuflady 15 cm, 1 szuflada 22,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15


Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego przedłużacz elektryczny na 5 gniazdek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie 16

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w trzy odchylane, boczne pojemniki przeznaczone na akcesoria (zamiast drucianego kosza) – jak na zdjęciu poniżej + pojemnik na igły mocowany do stelaża nad blatem wózka?

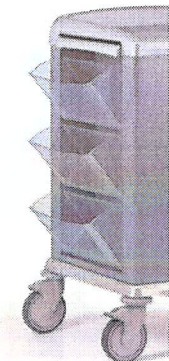


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 17

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na butlę z tlenem (jak na zdjęciu poniżej)?

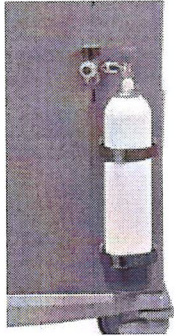

Odpowiedź:


Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do przetaczania zamocowany na stałe z boku wózka (bez możliwości zmiany jego wysokości)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

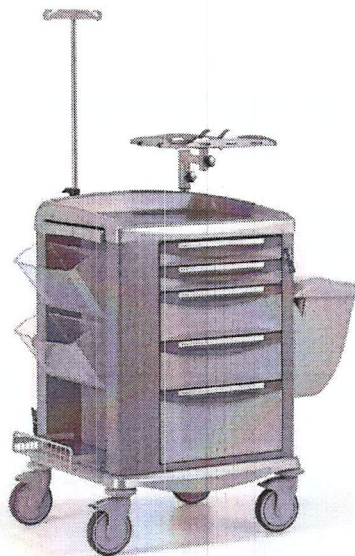

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)


Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o następujących parametrach:

Szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm),

-blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm,

-konstrukcja z 4 profili aluminiowych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację położenia wysokości szyn instrumentalnych (szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego),



- fronty szuflad aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor biały, szuflady z samodociągiem,
 - uchwyty szuflad wykonane z anodowanego aluminium lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
 - wypełnienie szafki (tył, boki) wykonane z lekkiego panelu kompozytowego aluminiowego, lakierowane proszkowo na kolor biały, wyposażone w materiał wyguszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje,
 - podstawa aluminiowa z odbojami, wyposażona w koła podwójne w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą,
 - elementy dekoracyjne (banda blatu górnego, profile aluminiowe, uchwyty szuflad, uchwyt do prowadzenia) lakierowane na wybrany kolor RAL,
 - uchwyt do prowadzenia montowany na stałe,
 - maksymalne obciążenie szuflady 10 kg,
- Wyposażenie wózka:
- 5 x wyciągane podziałki do szuflad, dzielące przestrzeń na 9 pól,
 - 5 x maty antypoślizgowe w szufladach,
 - szyny instrumentalne do mocowania wyposażenia dodatkowego, z możliwością regulacji wysokości,
 - blat boczny wysuwany, wykonany z aluminium, lakierowany proszkowo,
 - zamek centralny do szuflad,
 - wieszak kroplówki z 4 haczykami,
 - deska do przeprowadzania RKO,
 - półka pod defibrylator,
 - listwa zasilająca na 5 gniazd,
 - 2 x kosz z tworzywa sztucznego o pojemności 9L,
 - koszyk na akcesoria o wym. 295x95x85mm,
 - pojemnik na zużyte igły,
 - uchwyt do butli z tlenem.

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x575x1000 mm

Wymiary szafki: 600x500x805 mm

Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:

(przy wysokości frontów 2x97mm): 518x439x86 mm

(przy wysokości frontu 1x156mm): 518x439x145 mm

(przy wysokości frontów 2x175mm): 525x439x164 mm

[szerokość x głębokość x wysokość]

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny o powyższych parametrach.

Pytanie 20

Poz.3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach (bez wyposażenia) :

- szerokość: 662 mm
- głębokość: 594 mm
- wysokość: 1045 mm (wysokość do blatu 1015 mm).


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Poz.4-6_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu z ABS, z wyprofilowanymi z trzech stron burtami (stanowiącymi zintegrowane uchwyty do prowadzenia wózka) oraz niskim frontowym brzegiem, zapobiegające przed zsuwaniem się pojemników i sprzętu medycznego z blatu roboczego. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź:



Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22

Poz.8_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad wykonanych w całości (w tym fronty szuflad) z tworzywa ABS - bez szczelin i łączy, łatwe do utrzymania w czystości, z uchwytami na całej szerokości – szuflady. Oferowane szuflady są samo domykające, mają możliwość pełnego wysuwu oraz są wyjmowane (np. do mycia czy uzupełnienia zawartości) bez użycia narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Poz.10_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad bez mat antypoślizgowych, gdyż może to być element wyposażenie utrudniający utrzymanie szuflad w czystości. Dodatkowo w przypadku zastosowania w szufladach (zgodnie z wymogiem Zamawiającego) podziałek do segregacji leków maty antypoślizgowe nie są niezbędne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Poz.17_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wieszaka kroplówki z 2 hakami oraz wyposażonego standardowo w 3 uchylne, transparentne kieszenie boczne, w których można transportować jeszcze większą ilość kroplówek (jak również inne akcesoria medyczne), co jest rozwiązaniem korzystnym dla Użytkowników wózków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Poz.4_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 5 szuflad:

- dwie szuflady o wys. 7,6 cm
- dwie szuflady o wys. 15,6 cm
- jedna szuflada o wys. 23,6 cm.

Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Poz.18_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 4 szuflady:

- trzy szuflady o wys. 15,6 cm
- jedna szuflada o wys. 23,6 cm.

Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Poz.19_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast drucianego kosza na akcesoria medyczne, jednej z trzech uchylnych, transparentnych kieszeni bocznych, stanowiących standardowe wyposażenie wózka (ad. Pyt. 6, Poz. 17), przeznaczone do wygodnego przechowywania np. pojemnika na zużyte igły.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28

Poz.19_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast drucianego kosza na akcesoria medyczne o wymiarach: długość 35 x głębokość: 12 x wysokość: 13,5 cm.

Odpowiedź:

Wykonawca nie wskazał co oferuje zamiast drucianego kosza.

Pytanie 29

Poz.19_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast kosza na butlę z tlenem, uchwytu na butlę z tlenem z pasem zabezpieczającym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Poz.19_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast ruchomego uchwytu do przetaczania, wyprofilowanych z trzech stron blatu burt stanowiących trzy zintegrowane uchwyty do prowadzenia wózka. Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, gdyż umożliwia większą swobodę przy prowadzeniu wózka, gdyż nie jest wymuszone tylko z jednej jego strony.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)


Pytanie 31

Poz.3_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach (bez wyposażenia) :

- szerokość: 662 mm
- głębokość: 594 mm
- wysokość: 1050 mm (wysokość do blatu 1000 mm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 32

Poz.4-6_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu z ABS, z wyprofilowanymi z trzech stron burtami (stanowiącymi zintegrowane uchwyty do prowadzenia wózka) oraz niskim frontowym brzegiem, zapobiegające przed zsuwaniem się pojemników i sprzętu medycznego z blatu roboczego. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Poz.7_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego boki i tył wykonane są z profilowanego tworzywa sztucznego polistyrenu w kolorze pomarańczowym (przypisanym do wózków reanimacyjnych), charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Poz.8_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad wykonanych w całości (w tym fronty szuflad) z tworzywa ABS - bez szczelin i łączeń, łatwe do utrzymania w czystości, z uchwytami na całej szerokości – szuflady. Oferowane szuflady są samo domykające, mają możliwość pełnego wysuwu oraz są wyjmowane (np. do mycia czy uzupełnienia zawartości) bez użycia narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Poz.10_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad bez mat antypoślizgowych, gdyż może to być element wyposażenie utrudniający utrzymanie szuflad w czystości. Dodatkowo w przypadku zastosowania w szufladach (zgodnie z wymogiem Zamawiającego) podziałek do segregacji leków maty antypoślizgowe nie są niezbędne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szuflad bez mat antypoślizgowych.

Pytanie 36

Poz.16_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4 cichobieźnych kół pojedynczych, tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne. Koła antystatyczne w przypadku wózka reanimacyjnego, zwłaszcza wyposażonego w listwę elektryczną (zgodnie z wymogiem Zamawiającego), stanowią ważną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kół pojedynczych.

Pytanie 37



Poz.17_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wieszaka kroplówki z 2 hakami oraz wyposażonego standardowo w 2 uchylne, transparentne kieszenie boczne oraz półkę o regulowanej głębokości, w których można transportować jeszcze większą ilość kroplówek (jak również inne akcesoria medyczne), co jest rozwiązaniem korzystnym dla Użytkowników wózków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38

Poz.4_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 5 szuflad:



- dwie szuflady o wys. 7,6 cm
- dwie szuflady o wys. 15,6 cm
- jedna szuflada o wys. 23,6 cm.

Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39

Poz.18_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 4 szuflady:

- trzy szuflady o wys. 15,6 cm
- jedna szuflada o wys. 23,6 cm.

Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 40

Poz.19_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast drucianego kosza na akcesoria medyczne, jednej z dwóch uchylnych, transparentnych kieszeni bocznych, stanowiących standardowe wyposażenie wózka (ad. Pyt. 6, Poz. 17), przeznaczone do wygodnego przechowywania np. pojemnika na zużyte igły.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 41

Poz.19_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast drucianego kosza na akcesoria medyczne o wymiarach: długość 35 x głębokość: 12 x wysokość: 13,5 cm.

Odpowiedź:

Wykonawca nie wskazał co oferuje zamiast drucianego kosza.

Pytanie 42

Poz.19_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast kosza na butlę z tlenem, uchwytu na butlę z tlenem z pasem zabezpieczającym, który jest wyprofilowany w tylnej ścianie wózka, obok przestrzeni (z zabezpieczeniem) do umieszczenia cewników, co zwiększa funkcjonalność oferowanego wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Poz.19_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiast ruchomego uchwytu do przetaczania, wyprofilowanych z trzech stron burt stanowiących trzy zintegrowane uchwyty do prowadzenia wózka. Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, gdyż umożliwia większą swobodę przy prowadzeniu wózka, gdyż nie jest wymuszone tylko z jednej jego strony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)

PYTANIA DO PAKIETU NR 2

Pytanie 1

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażone w intuicyjne pokrętko do nawigacji, wyboru trybu pracy w zakresie: wyłączony, tryb AED, tryb manualny, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączenia) wyposażony w mniejszą liczbę przycisków? Liczba przycisków jest zależna od konstrukcji defibrylatora.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażone w 1 gniazdo akumulatorowe oraz akumulator o dużej pojemności spełniający wszystkie opisane wymagania w zakresie czasu pracy na akumulatorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt.23. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w możliwość programowania energii w trybie defibrylacji ręcznej i AED, 1, 2 i 3 wyładowania min. W przedziale od: 10 do 360 J?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 4

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt.25. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w zakres pomiaru częstości akcji serca HR 15-300 /min.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 5

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt.26. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony we wzmacnienie sygnału EKG min. 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 cm/Mv oraz autowzmacnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.35 Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w nadzór bezdechu: min. Od 10 do 40 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt.37 Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie szerszym od 60 do 180 sekund oraz wyłączenia alarmów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.41 Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony we wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 50 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażone w intuicyjne pokrętko do nawigacji, wyboru trybu pracy w zakresie: wyłączony, tryb AED, tryb manualny, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączenia) wyposażony w mniejszą liczbę przycisków? Liczba przycisków jest zależna od konstrukcji defibrylatora.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażone w 1 gniazdo akumulatorowe oraz akumulator o dużej pojemności spełniający wszystkie opisane wymagania w zakresie czasu pracy na akumulatorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 11

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.23. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w możliwość programowania energii w trybie defibrylacji ręcznej i AED, 1, 2 i 3 wyładowania min. W przedziale od: 10 do 360 J ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 12

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.25. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w zakres pomiaru częstości akcji serca HR 15-300 /min.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.26. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony we wzmocnienie sygnału EKG min. 0,25, 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 cm/Mv oraz autowzmocnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.35 Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w nadzór bezdechu: min. Od 10 do 40 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.44 Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie szerszym od 60 do 180 sekund oraz wyłączenia alarmów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.48 Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony we wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 50 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator o wadze 7,2 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.


Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator o wymiarach 220mm x 345mm x 301mm (szerokość x wysokość x głębokość)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.



Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator o klasie równoważnej IPX4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem poziomu energii wstrząsu od 100~360 J ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem pomiaru akcji serca 15-350 / min ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG 0,125 cm/Mv; x0,25; cm/Mv; 0,5 cm/Mv; 1,0 cm/Mv; 2,0 cm/Mv; 4,0 cm/Mv; AUTO ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem 40-210 imp/min ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z szerokością impulsu stymulatora 20 msek. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością czasowego zawieszenia alarmu z regulacją w zakresie od 60 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością rozbudowy pamięci za pomocą kart SD oraz port USB. Z parametrami pamięci wewnętrznej: 2000 zestawów danych pomiarowych NIBP, 200 zapamiętanych zdarzeń alarmów parametrów i 120-godzinny przegląd krzywej jednokanałowej, do 5



raportów EKG przypadku dla każdego pacjenta, 1000 zdarzeń dotyczących pacjentów i do 60 minut przechowywania zapisów AED dla każdego pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator o wadze 7,2 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator o wymiarach 220mm x 345mm x 301mm (szerokość x wysokość x głębokość) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator o klasie równoważnej IPX4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem poziomu energii wstrząsu od 100~360 J ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem pomiaru akcji serca 15-350 / min ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG 0,125 cm/Mv; x0,25; cm/Mv; 0,5 cm/Mv; 1,0 cm/Mv; 2,0 cm/Mv; 4,0 cm/Mv; AUTO ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 33

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem 40-210 imp/min ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 34

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z szerokością impulsu stymulatora 20 msek. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością czasowego zawieszenia alarmu z regulacją w zakresie od 60 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36

Poz. 2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością rozbudowy pamięci za pomocą kart SD oraz port USB. Z parametrami pamięci wewnętrznej: 2000 zestawów danych pomiarowych NIBP, 200 zapamiętanych zdarzeń alarmów parametrów i 120-godzinny przegląd krzywej jednokanałowej, do 5 raportów EKG przypadku dla każdego pacjenta, 1000 zdarzeń dotyczących pacjentów i do 60 minut przechowywania zapisów AED dla każdego pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.2- Czy Zamawiający dopuści Ciężar urządzenia do 7 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt.3- Czy Zamawiający dopuści przybliżone wymiary: 23,5 cm (W) x 29 cm (S) x 20,5 cm (G) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt.7- Czy Zamawiający dopuści defibrylator z Czasem pracy na akumulatorze: 2,5 godz. W przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 40

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.8- Czy Zamawiający dopuści jedno gniazdo na akumulator, łatwo wyciągany bez użycia narzędzi ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 41

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.10- Czy Zamawiający dopuści Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora widoczny monitorze urządzenia po uprzednim uruchomieniu oraz stały wskaźnik gotowości urządzenia widoczny na panelu głównym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.13- Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w defibrylację ręczną w zakresie od 1 do 200 J ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.19- Czy Zamawiający dopuści Energię wyładowania w trybie AED -150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.22- Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez funkcji Metronom ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.23- Czy Zamawiający dopuści Energię wyładowania w trybie AED -150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.25- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 16-350 B/minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.


pkt.26- Czy Zamawiający dopuści wzmocnień sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; automatyczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.



pkt.32- Czy Zamawiający dopuści natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum od 10 do 200 Ma ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.33- Czy Zamawiający dopuści pomiar oddechów przy posiadaniu modułu Co2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.35- Czy Zamawiający dopuści pomiar bezdechu:

Zakres alarmu:

- Dolny próg: 0–99 o/min (dorośli i niemowlęta/dzieci)
- Górny próg: 10–100 o/min (dorośli i niemowlęta/dzieci)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.39- Czy Zamawiający dopuści ekran kolorowy LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 640x480 pikseli ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.40- Czy Zamawiający dopuści prezentację na ekranie 3 kanałów dynamicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

pkt.41- Czy Zamawiający dopuści wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 50 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54


Poz. 1 – Defibrylator ogólnoszpitalny – 2 szt.

Pkt.42- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością archiwizacji danych :

Podsumowanie zdarzeń w pamięci wewnętrznej: Monitor/defibrylator może przechowywać maksymalnie 8-godzinny zapis 2 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej pletyzmograficznej, 1 krzywej kapnogramu, krzywych badawczych (tylko tryb AED), zdarzeń i danych trendów dla każdego podsumowania zdarzeń. Maksymalna pojemność wynosi około 50 podsumowań zdarzeń o długości około 30 minut. Możliwość magazynowania zdarzeń na zewnętrznej pamięci USB ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 55

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.2- Czy Zamawiający dopuści Ciężar urządzenia do 7 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt.3- Czy Zamawiający dopuści przybliżone wymiary: 23,5 cm (W) x 29 cm (S) x 20,5 cm (G) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

Pkt.7- Czy Zamawiający dopuści defibrylator z Czasem pracy na akumulatorze: 2,5 godz. W przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.8- Czy Zamawiający dopuści jedno gniazdo na akumulator, łatwo wyciągany bez użycia narzędzi ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.10- Czy Zamawiający dopuści Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora widoczny monitorze urządzenia po uprzednim uruchomieniu oraz stały wskaźnik gotowości urządzenia widoczny na panelu głównym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.13- Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w defibrylację ręczną w zakresie od 1 do 200 J ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.



pkt.19- Czy Zamawiający dopuści Energię wyładowania w trybie AED -150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.



pkt.22- Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez funkcji Metronom ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.23- Czy Zamawiający dopuści Energię wyładowania w trybie AED -150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

dot. pkt.25- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 16-350 B/minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

dot. pkt.26- Czy Zamawiający dopuści wzmocnień sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; automatyczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.32- Czy Zamawiający dopuści natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum od 10 do 200 Ma ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.33- Czy Zamawiający dopuści pomiar oddechów przy posiadaniu modułu Co2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.35- Czy Zamawiający dopuści pomiar bezdechu:

Zakres alarmu:

- Dolny próg: 0–99 o/min (dorośli i niemowlęta/dzieci)
- Górny próg: 10–100 o/min (dorośli i niemowlęta/dzieci)

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.38- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę ?

Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.39- Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru pulsu 30 do 300/min dokładność $\pm 2\%$ lub 1 u/min (większa z wartości) oraz dokładność saturacji SpO₂ 0 do 100% +/-3%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.46- Czy Zamawiający dopuści ekran kolorowy LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 640x480 pikseli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.47- Czy Zamawiający dopuści prezentację na ekranie 3 kanałów dynamicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.

pkt.48- Czy Zamawiający dopuści wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 50 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74

Poz.2 – Defibrylator – Izba Przyjęć Dziecięca – 1 szt.


Pkt.49- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością archiwizacji danych :

Podsumowanie zdarzeń w pamięci wewnętrznej: Monitor/defibrylator może przechowywać maksymalnie 8-godzinny zapis 2 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej pletyzmograficznej, 1 krzywej kapnogramu, krzywych badawczych (tylko tryb AED), zdarzeń i danych trendów dla każdego podsumowania zdarzeń. Maksymalna pojemność wynosi około 50 podsumowań zdarzeń o długości około 30 minut. Możliwość magazynowania zdarzeń na zewnętrznej pamięci USB ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.



PYTANIA DO SWZ

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść kryterium oceny ofert B. **Termin realizacji zamówienia (dostawy) – wartość kryterium – 20 %** w pkt 35 SWZ, jak poniżej:

*„Zamawiający wymaga aby dostawa przedmiotu zamówienia była zrealizowana w terminie **nie dłuższym niż 65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia, za który można otrzymać punkty wynosi do 15 dni kalendarzowych. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin” wynosi 20 pkt.*

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

- do 65 dni kalendarzowych (\leq) – 0 punktów*
- do 40 dni kalendarzowych (\leq) – 10 punktów*
- do 15 dni kalendarzowych (\leq) – 20 punktów*

Brak wpisania/wskazania w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje najdłuższy niepunktowany termin realizacji zamówienia.”

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 42 dni od daty zawarcia umowy dla pakietu 1. Pragniemy zauważyć, że czas ten jest niezbędny na wyprodukowanie i sprowadzenie wyrobu z zagranicy, zważywszy na tak dużą ilość jak 30 sztuk.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

PYTANIA DO WZORU UMOWY

Pytanie 1


dot. §5 ust.3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu, w zakresie pakietu nr 1. Przedmiot zamówienia dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź:

W przypadku asortymentu w zakresie pakietu nr 1, zapis wymogu montażu nie będzie miał zastosowania.

Pytanie 2

dot. §5. ust.3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w pakiecie nr 1 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi. Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenie ceny ofertowej.



Odpowiedź:

W przypadku asortymentu w zakresie pakietu nr 1, zapis wymogu przeszkolenia personelu nie będzie miał zastosowania.

Pytanie 3

dot. §7 ust.5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w zakresie pakietu nr 1. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź:

W przypadku asortymentu w zakresie pakietu nr 1, zapis wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego nie będzie miał zastosowania.

Pytanie 4

dot. §7 ust.8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że w przypadku asortymentu, dla którego producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów (dot. pakiet nr 1), zapis wskazanego punktu nie będzie miał zastosowania.

Odpowiedź:

W przypadku asortymentu w zakresie pakietu nr 1, zapis wymogu przeprowadzania przeglądów nie będzie miał zastosowania.

Pytanie 5

Dot. § 3 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy dla pakietu 1 powyższego zapisu, jako nie dotyczącego przedmiotu umowy. Oferowane wózki są meblem medycznym nieposiadającym oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wskazał, iż zapis § 3 ust. 2 dotyczy Pakietu nr 2.

Pytanie 6

Dot. § 8 ust. 1 pkt. 2b

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie urządzenia/asortymentu zgodnego z umową do wysokości 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 7

Dot. § 8 ust. 1 pkt. 2c


Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi do wysokości 50,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 8

Dot. § 3 ust. 5, § 5 ust. 3



Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie wózków z pakietu 1. Oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź:

W przypadku asortymentu w zakresie pakietu nr 1, zapis wymogu przeszkolenia personelu nie będzie miał zastosowania.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu/uruchomienia/installacji w zakresie wózków z pakietu 1. Oferowane wózki dostarczane są gotowe do użytku. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź:

W przypadku asortymentu w zakresie pakietu nr 1, zapis wymogu montażu/uruchomienia/installacji nie będzie miał zastosowania.

Pytanie 10

Dot. umowa § 7 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z pakietu 1, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Odpowiedź:

W przypadku asortymentu w zakresie pakietu nr 1, zapis wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych nie będzie miał zastosowania.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **21.02.2024 r. - godz. 9:00**
- termin otwarcia ofert: **21.02.2024 r. - godz. 9:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ **Termin związania ofertą**, nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.03.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl