

Kielce, 24.10.2024 r.

znak sprawy EZ/195/2024/ES

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### Pytanie 1


##### Dot. Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta:



cewnik czasowy do hemodializy wykonany z termoaktywnego poliuretanu, przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, fluoroskopii, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35'' x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.

Dla pozycji nr 1 -Cewniki do dializy dwuświatłowe, ramiona proste o średnicy 12F oraz 14F, długości 15/20/24cm, lub zagięte 12F oraz 14F- długości 15/20 cm.

Dla pozycji 2 - Cewniki do dializy trójświatłowe ramiona proste 13F o długości 15/20/24 cm lub zagięte 13F- długości 15/20 cm.

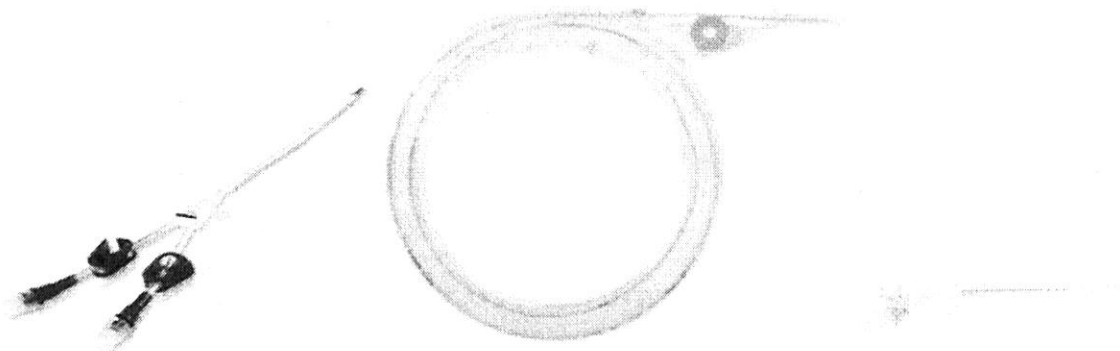

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.



## Pytanie 2

### Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 1 - Cewniki dwuświatłowe, wysokoprzepływowe, proste lub zagięte, wykonany z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawie z: strzykawką 5 ml, igłą do wkłuwania rozm. 18G./7 cm prowadnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy 12Fr / 15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane, cewnik o średnicy 12 F, długości 15/20/24 cm do wyboru przez zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

## Pytanie 3

### Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 2 - Cewniki trzyświatłowe, wysokoprzepływowe, proste lub zagięte, wykonany z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawie z: strzykawką 5 ml, igłą do wkłuwania rozm. 18G./7 cm prowadnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy 12Fr / 15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane, cewnik o średnicy 12 F, długości 15/20/24 cm do wyboru przez zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

## Pytanie 4


### Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych,  
- średnica 11 FR i 13 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm – ramiona proste  
- średnica 11 FR i 13 FR - długość 15 cm, 20 cm, – ramiona zakrzywione  
do wyboru przez Zamawiającego ?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie 5**

**Dot. Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6**

**Dot. Pakietu nr 1 poz.1**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 cewników czasowych silikonowych dwukanałowych o średnicy: 11,5 Fr i 13,5 Fr i długościach: 15 cm, 20cm i 24 cm bez powłoki bizmutowej, z otworami bocznymi i klipsem umożliwiającym zagięcie ramion w zestawach do inplantacji ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7**

**Dot. Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie pakietu nr 1 poz. 1 i utworzy nowy pakiet?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w podanym rodzaju zestawów do blokad ciągłych nerwów obwodowych igłę o rozmiarze 21Gx68mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 9**

**Dot. par 10 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b wzoru umowy**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

„1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.”

Proponowana minimalna wartość kary 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki jest nadmiernie wysoka i nieproporcjonalna do wartości zamówienia oraz odbiegająca od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**Pytanie 10**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 2**


Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z jednolitego materiału (medycznego PE)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 11**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści prowadnicę z plastikowym elementem zabezpieczającym zagiętą końcówkę prowadnicy (zamiast futerału)?



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 12

##### Dot. Pakietu nr 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Delikatny mankiet
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie
- Rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie
- Barwny kod rozmiarów
- Uniwersalny łącznik 15 mm
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana folia/papier

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 13

##### Dot. Pakietu nr 7, poz. 5

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankiem o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, średnicą mankieta i numerem LOT
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpięścieni
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki;

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.



#### Pytanie 14

##### Dot. Pakietu nr 7, poz. 6

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankieta o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Potrójny znacznik głębokości
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki

**Odpowiedź:** Pytanie nie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia.



### Pytanie 15

#### Dot. Pakietu nr 7, poz. 7

Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 16

#### Dot. Pakietu nr 7, poz. 8

Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak


**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 17

#### Dot. Pakietu nr 7, poz. 9

Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M



- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 18

##### Dot. Pakietu nr 7, poz. 10

Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Brak informacji o poziomie nawilżania.

#### Pytanie 19

##### Dot. Pakietu nr 7, poz. 11

Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak


**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Wymagany filtr elektrostatyczny o przestrzeni martwej jak w opisie.

#### Pytanie 20

##### Dot. Pakietu nr 7, poz. 12

Czy zamawiający dopuści łyżki o parametrach:

- Wykonane ze stopu metalu
- Światłowod z tworzywa sztucznego o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie
- Zatrząsk kulkowy w podstawie koloru zielonego



- Dostępne w wersji z osłoniętym światłowodowym lub nieosłoniętym zapewniającym doświetlenie wnętrze jamy ustnej i gardła
- Kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3
- Oznakowanie łyżek typu Macintosh: nr serii, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na części metalowej łyżki
- Jednorazowego użytku
- Czyste mikrobiologicznie
- Opakowanie foliowe

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Brak informacji o rozmiarach.

### Pytanie 21

#### Dot. Pakietu nr 7, poz. 13

Czy zamawiający dopuści łyżki o parametrach:

- Wykonane ze stopu metalu
- Światłowód z tworzywa sztucznego o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie
- Zatrząsk kulkowy w podstawie koloru zielonego
- Dostępne w wersji z osłoniętym światłowodowym lub nieosłoniętym zapewniającym doświetlenie wnętrze jamy ustnej i gardła
- Kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3
- Oznakowanie łyżek typu Miller: nr serii, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), na części metalowej łyżki,
- Jednorazowego użytku
- Czyste mikrobiologicznie
- Opakowanie foliowe

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Brak informacji o rozmiarach.

### Pytanie 22

#### Dot. Pakietu nr 7, poz. 14

Czy zamawiający dopuści uchwyt o parametrach:

- Radełkowany uchwyt zapewnia stabilny chwyt podczas użytkowania
- Przeznaczone wyłącznie dla jednego pacjenta
- Źródło światła LED 2500 LUX
- Uchwyt Led z wbudowanymi bateriami
- Dostępne w całości z metalu i półmetalową konstrukcją
- Ekonomiczne z wysokiej jakości
- Wykonany z lekkiego aluminium
- Kompatybilna ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3
- Czyste mikrobiologicznie
- Pakowanie pojedynczo

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Brak informacji o rozmiarach oraz wadze uchwytu.

Wprowadzone wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

Z-ca Dyrektora  
ds. lecznictwa

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska  
inspektor

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 41/30-33-516 fax. 41/366-00-14  
e-mail: [magdalena.kuszewska@wszkielce.pl](mailto:magdalena.kuszewska@wszkielce.pl)

Krzysztof Biłas

