




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/62/2025/MK

Kielce, dnia 22.04.2025r.


Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na „*Sukcesywne dostawy jednorazowych ostrzy do strzygarek wraz z strzygarkami chirurgicznymi dla potrzeb WSZZ w Kielcach*”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy pozycji nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści Ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała; Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,21 mm, szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką, którą chcemy zaproponować w pozycji 2.



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2- dotyczy pozycji nr 2


Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści strzygarkę chirurgiczną wyposażoną w dwie diody LED: poziom i stan naładowania Napięcie / natężenie robocze 3,25 V DC / 390 mA (maks.) Waga 121 gramów Wymiary 153 × 49 × 39 mm (wys. × szer. × gł.) Czas do całkowitego naładowania Maksymalnie 17 godzin. Hałas w trakcie pracy w zakresie 69-75 db . Wodoszczelność: stopień ochrony IPX7 Żywotność akumulatora Minimum 350 cykli Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min.

Ładowarka kompatybilna ze strzygarką chirurgiczną zaproponowaną w pozycji 2 Waga ładowarki: 200–250 g ±10 g . Źródło zasilania: 100–240 V AC; 50–60 Hz, 30 mA . Możliwość montażu ściennego Wymiary: 80 × 61 × 44 mm (wys. × szer. × gł.), długość przewodu: 1870 mm.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl

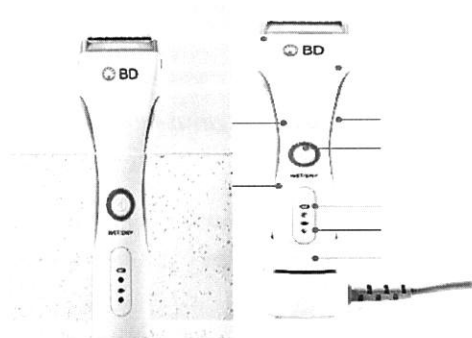

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia strzygarek z ładowarką na czas trwania umowy, wraz z pierwszą dostawą ostrzy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt długi czas oczekiwania pełnego naładowania.

Pytanie nr 3- dotyczy pozycji nr 2

Prosimy o dopuszczenie 150 min czasu pracy i czasu ładowania do 2 godzin. Prosimy o dopuszczenie strzygarki wyposażonej w trzystakresową, obrotową głowicę (kąt0, kąt 45° w lewo, kąt 45° w prawo), do stosowania na mokro i sucho.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, spełnienia pozostałych wymagań stawianych przez Zamawiającego w pozycji 1 oraz kompatybilności zaoferowanych ostrzy z pozycją nr 2.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

mgr inż. Stefan Bąk