

Znak sprawy: EZ/165/2025/MW

Kielce, dnia 15.01 2026 r.*Do wszystkich zainteresowanych*


*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) pn. **Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą dotyczącą informatyzacji w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni**, znak sprawy: EZ/165/2025/MW*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA+MODYFIKACJA+ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dotyczy – Załącznik nr 2.28_Opis Parametrów Technicznych Regał listwowy nacienny uniwersalny

Czy Zamawiający dopuści wieszak do obuwia o wymiarach: 570x180x300mm, spełniający wszystkie pozostałe parametry? Poniżej wizualizacja oferowanego wieszaka

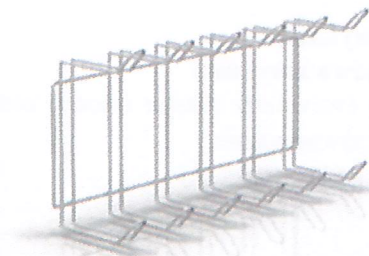

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametry wieszaka do obuwia o wymiarach 570x180x300mm,

Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik nr 2.32_Opis Parametrów Technicznych Regał uniwersalny

Czy Zamawiający dopuści regał wykonany z blachy o grubości 1,2mm, spełniający wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru na grubość blachy 1,2mm.

Pytanie 3 Dotyczy:**Załącznik nr 2.39_Opis Parametrów Technicznych Stół do kontroli i pakowania****Załącznik nr 2.47_Opis Parametrów Technicznych Stół do kontroli i pakowania****Załącznik nr 2.48_Opis Parametrów Technicznych Stół do kontroli i pakowania****Załącznik nr 2.51_Opis Parametrów Technicznych Stół ociekowy****Załącznik nr 2.55_Opis Parametrów Technicznych Stół roboczy****Załącznik nr 2.57_Opis Parametrów Technicznych Stół ociekowy****Załącznik nr 2.60_Opis Parametrów Technicznych Stół ociekowy****Załącznik nr 2.61_Opis Parametrów Technicznych Stół ociekowy****Załącznik nr 2.65_Opis Parametrów Technicznych Stół roboczy**

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w blat wykonany z blachy o grubości 1,2mm, spełniający wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów na grubość blachy 1,2mm.

Pytanie 4 Dotyczy:**Załącznik nr 2.33_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa zamykana****Załącznik nr 2.35_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa aktowa zmykana**

Czy Zamawiający dopuści szafę wyposażoną w półki przestawne co 45mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów na półki przestawne co 45mm

Pytanie 5 Dotyczy:**Załącznik nr 2.33_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa zamykana****Załącznik nr 2.35_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa aktowa zmykana**

Czy Zamawiający dopuści szafę ryglowaną w 2 punktach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów na szafę ryglowaną w 2 punktach

Pytanie 6 Dotyczy:**Załącznik nr 2.33_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa zamykana****Załącznik nr 2.35_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa aktowa zmykana**

Czy Zamawiający dopuści szafę wyposażoną w drzwi z podwójnej blachy (wewnątrz plaster miodu) zamiast wewnętrznego profilu wzmacniającego drzwi? Oferowane rozwiązanie jest równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 7 Dotyczy:**Załącznik nr 2.33_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa zamykana****Załącznik nr 2.35_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa aktowa zmykana**

Czy Zamawiający dopuści szafę, w której maksymalne obciążenie półki wynosi 30 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szaf w których maksymalne obciążenie półki wynosi 30 kg.

Pytanie 8 Dotyczy:**Załącznik nr 2.33_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa zamykana****Załącznik nr 2.35_Opis Parametrów Technicznych Szafa metalowa aktowa zmykana**

Czy Zamawiający dopuści szafę wyposażoną w stopki z tworzywa z możliwością regulacji w zakresie 20mm? Oferowane rozwiązanie jest równoważne

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stopki z tworzywa z możliwością regulacji w zakresie 20mm.

Pytanie 9 Dotyczy - Załącznik nr 2.38_Opis Parametrów Technicznych Stół do kontroli i pakowania bielizny ze stali kwasoodpornej z podświetla-nym blatem

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podświetlany blat grubości 1,2mm (dotyczy części nierdzewnej – rama) o wymiarach 1400x900mm, wyposażony w szybę bezpieczną, mleczną o wymiarach 1100x720mm (wymiarzy zewnętrzne stołu 1400x900x850mm)? Oferowany stół spełnia wszystkie pozostałe parametry. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w podświetlany blat grubości 1,2mm (dotyczy części nierdzewnej – rama) o wymiarach 1400x900mm, wyposażony w szybę bezpieczną, mleczną o wymiarach 1100x720mm.

Pytanie 10 Dotyczy: Załącznik nr 2.40_Opis Parametrów Technicznych Taboret obrotowy jezdny z oparciem pleców

Czy Zamawiający dopuści taboret z zakresem regulacji 490/630mm, spełniający wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taboret o parametrach regulacji w zakresie 490/630mm.

Ptanie 11 Dotyczy: Załącznik nr 2.41_Opis Parametrów Technicznych Wózek ze stali kwasoodpornej do papieru i włóknin

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (dłxszxwys) w mm: 1100x400x1000mm, spełniający wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wózka o w/w parametrach

Pytanie 12 Dotyczy: Załącznik nr 2.45_Opis Parametrów Technicznych Regał listwowy mobilny

Czy Zamawiający dopuści regał o wymiarach, jak w SWZ tj. **530**x600x1500 mm (długość podana bez uchwytów) oraz o wymiarach zewnętrznych (uwzględniających dwa uchwyty do prowadzenia) o wymiarach

690x600x1500mm? Poniżej wizualizacja oferowanego wyrobu. Oferowany regał spełnia wszystkie pozostałe parametry?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Regał listwowy mobilny o wymiarach 690x600x1500mm.

Pytanie 13 Dotyczy: Załącznik nr 2.54_Opis Parametrów Technicznych Regał ażurowy

Czy Zamawiający dopuści regał wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), spełniający wszystkie pozostałe parametry? Oferowane rozwiązanie jest równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od oferentów dostawy regału w wykonanego ze stali nierdzewnej i dopuszcza regał wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść załącznika 2.54 do SWZ.

Pytanie 14 Dotyczy: Które elementy wskazane w projekcie technologii są przedmiotem dostaw w ramach niniejszego postępowania, prosimy o uzupełnienie OPZ o wykaz asortymentowo-ilościowy.

Odpowiedź:

Asortyment będący przedmiotem zamówienia wyszczególniony został w Załączniku nr 2 do SWZ_Formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie 15 Dotyczy:

Wskazany termin dostaw wyposażenia centralnej sterylizacji określony na 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy jest zbyt krótki. Myjnie, sterylizatory, meble stalowe nie są produktem gotowym dostępnym „od ręki” – musi zostać wyprodukowany na zamówienie. Prosimy o wydłużenie tego terminu do min. 90 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin dostaw wyposażenia centralnej sterylizacji na okres 90 dni.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuj treść:

- *SWZ Pkt 6 tiret 1, który otrzymuje brzmienie:
„dostawa wraz z wniesieniem do pomieszczeń magazynowych, nowego, nieużywanego, nie rekondycjonowanego i nie powystawowego sprzętu i wyposażenia medycznego w terminie 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy”*

- *Załącznika nr 3 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienie publicznego § 2 ppkt1.1, który otrzymuje brzmienie:
„1.1 Etap I - I Dostawa wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń magazynowych, nowego, nieużywanego, nie rekondycjonowanego i nie powystawowego, sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni, którego parametry i warunki techniczne wyspecyfikowano w załączniku nr opis przedmiotu zamówienia - w terminie 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy, realizacja zadania winna być potwierdzona ilościowo/jakościowym protokołem odbioru dostawy.”*

Pytanie 16

Prosimy o uwzględnienie w harmonogramie realizacji okresu niezbędnego do wykonania i akceptacji projektów adaptacyjnych, dopiero ich wykonanie i akceptacja może stanowić podstawę do zlecenia produkcji wyposażenia.

Odpowiedź:

Ze względu na odpowiedź na Pytanie nr 15 i wydłużenie terminu dostaw powyższy termin pozostaje bez zmian.

Pytanie 17

W zakresie realizacji zabudów meblowych Zamawiający wymaga wykonania projektów warsztatowych w celu uzgodnienia ich z Zamawiającym. Prosimy o uwzględnienie tych wymagań w terminach realizacji poszczególnych zadań.

Odpowiedź:

Ze względu na odpowiedź na Pytanie nr 15 i wydłużenie terminu dostaw powyższy termin pozostaje bez zmian..

Pytanie 18

Prosimy o wskazanie oczekiwanego terminu realizacji dostaw i zamontowania mebli do którego z wymagań terminowych należy je przypisać ?

Odpowiedź:

Termin realizacji dostaw mebli - zgodnie z etap I

Zamontowanie mebli – zgodnie z etapem V

Pytanie 19

Prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający musi dokonać oceny projektu warsztatowego zabudów meblowych wniesienia uwag i akceptacji, okresy stanowią składniki okresu realizacji. Brak zobowiązania terminowego Zamawiającego w tym zakresie może wydłużać termin realizacji zadania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona oceny projektu warsztatowego zabudów meblowych w terminie 7 dni od ich przedłożenia. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 20 Dotyczy: Załącznik nr 2.6_Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich Dot. L.p.2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające deklarację zgodności z rozporządzeniem dot. wyrobów medycznych – 2017/745 i posiadające oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 12 c tiret 2. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.6_Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich w zakresie Pkt 2.

Pytanie 21 Dotyczy: Załącznik nr 2.6_Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. L.p.16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające skuteczne przechowywanie do 30 dni bez wzrostu poziomu drobnoustrojów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością przechowywania do 30 dni bez wzrostu poziomu drobnoustrojów

Pytanie 22 Dotyczy: Załącznik nr 2.7_Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia narzędzi

Dot. L.p.3

Prosimy o wykreślenie wymogu spełnienia normy PN EN ISO 15883 – norma ta podaje wymagania dla myjni – dezynfektorów a nie dla szaf do suszenia narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia normy PN EN ISO 15883 dla asortymentu opisanego w Załączniku nr 2.7. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść:

- *Załącznika nr 2.7_ Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia narzędzi poprzez wykreślenie Pkt. 3.*
- *SWZ Pkt 12 c tiret 6, który otrzymuje brzmienie:*

„Certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO PN -EN ISO 15883 dla Załącznika 2-7, 2.8, 2.9, 2.10, ~~2.11~~, 2.12, ~~2.18~~”

Pytanie 23 Dotyczy: Załącznik nr 2.7_Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia narzędzi

Dot. L.p.15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dotykowy panel kontrolny z kolorowym wyświetlaczem, LCD pozwala na ustawienie parametrów suszenia, czyli temperatury i czasu w zależności od produktów przeznaczonych do obróbki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w dotykowy panel kontrolny z kolorowym wyświetlaczem, LCD pozwalający na ustawienie parametrów suszenia, czyli temperatury i czasu w zależności od produktów przeznaczonych do obróbki.

Pytanie 24 Dotyczy: Załącznik nr 2.11_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca

Dot. L.p.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie nie będące wyrobem medycznym? Nie ma wymogu by urządzenia realizujące mycie ultradźwiękowe były wyrobami medycznymi a na rynku dostępne są zarówno urządzenia będące sklasyfikowane jako urządzenia medyczne jak i nie medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia które nie jest wyrobem medycznym.

Pytanie 25 Dotyczy: Załącznik nr 2.11_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca

Dot. L.p.11

Prosimy o wykreślenie wymogu spełnienia normy PN EN ISO 15883 – norma ta podaje wymagania dla myjni –dezynfektorów a nie dla myjni ultradźwiękowych.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia normy PN EN ISO 15883 dla asortymentu opisanego w Załączniku nr 2.11. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść:

- *Załącznika nr 2.1_ Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia narzędzi poprzez wykreślenie Pkt. 3.*
- *SWZ Pkt 12 c tiret 6, który otrzymuje brzmienie:*

„Certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO PN -EN ISO 15883 dla Załącznika 2-7, 2.8, 2.9, 2.10, 2-11, 2.12, 2-18”

Pytanie 26 Dotyczy: Załącznik nr 2.11_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca

Dot. L.p.12

Prosimy o dopuszczenie urządzenia którego producent nie spełnia wymogu posiadania: Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 – jeżeli urządzenie nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeżeli urządzenie nie jest wyrobem medycznym.

Pytanie 27 Dotyczy: Załącznik nr 2.49_Opis Parametrów Technicznych Kosze sterylizacyjne ze stali kwasoodpornej

Dot. L.p.3

Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania: Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.49_ Opis Parametrów Technicznych Kosze sterylizacyjne ze stali kwasoodpornej poprzez wykreślenie punktu 3.

Pytanie 28 Dotyczy: Załącznik nr 2.59_Opis Parametrów Technicznych Kosze sterylizacyjne ze stali kwasoodpornej

Dot. L.p.3

Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania: Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.59_ Opis Parametrów Technicznych Kosze sterylizacyjne ze stali kwasoodpornej poprzez wykreślenie punktu 3.

Pytanie 29 Dotyczy: Załącznik nr 2.56_Opis Parametrów Technicznych Stelaż na wózki wsadowe myjni

Dot. L.p.6 Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania: Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO

9001 (lub równoważne).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.56_ Opis Parametrów Stelaż na wózki wsadowe myjni poprzez wykreślenie punktu 6.

Pytanie 30 Dotyczy: Załącznik nr 2.3_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 12 STE

Dot. L.p.28

Prosimy o doprecyzowania czy Zamawiający wymaga takiego wyposażenia urządzenia aby wymagany program posiadał opisaną funkcjonalność bez konieczności używania elementów/testów jednorazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 31 Dotyczy: Załącznik nr 2.4_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 8 STE

Dot. L.p.27

Prosimy o doprecyzowania czy Zamawiający wymaga takiego wyposażenia urządzenia aby wymagany program posiadał opisaną funkcjonalność bez konieczności używania elementów/testów jednorazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 32 Dotyczy: Załącznik nr 2.5_Opis Parametrów Technicznych Sterylizator parowy 4 STE

Dot. L.p.28

Prosimy o doprecyzowania czy Zamawiający wymaga takiego wyposażenia urządzenia aby wymagany program posiadał opisaną funkcjonalność bez konieczności używania elementów/testów jednorazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 33 Dotyczy: Załącznik nr 2.18_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Dot. L.p.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie nie będące wyrobem medycznym? Nie ma wymogu by urządzenia realizujące mycie ultradźwiękowe były wyrobami medycznymi a na rynku dostępne są zarówno urządzenia będące sklasyfikowane jako urządzenia medyczne jak i nie medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również urządzenie które nie jest wyrobem medycznym. Jeżeli Wykonawca zaoferuje urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym nie ma obowiązku skłaniania dokumentów wskazanych w SWZ Pkt 12 c tiret 2.

Pytanie 34 Dotyczy: Załącznik nr 2.18_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Dot. L.p.5

Prosimy o wykreślenie wymogu spełnienia normy PN EN ISO 15883 – norma ta podaje wymagania dla myjni – dezynfektorów a nie dla myjni ultradźwiękowych.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia normy PN EN ISO 15883 dla asortymentu opisanego w Załączniku nr 2.18. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść:

- *Załącznika nr 2.18_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca poprzez wykreślenie punktu 5.*
- *SWZ Pkt 12 c tiret 6 który otrzymuje brzmienie:*

„Certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO PN -EN ISO 15883 dla Załącznika 2-7, 2.8, 2.9, 2.10, ~~2.11~~, 2.12, ~~2.18~~”

Pytanie 35 Dotyczy: Załącznik nr 2.18_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Dot. L.p.12

Prosimy o dopuszczenie urządzenia którego producent nie spełnia wymogu posiadania: Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 – jeżeli urządzenie nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 Dotyczy: Załącznik nr 2.18_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi nych

Dot. L.p.3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wolnostojące o gabarytach: 900 x 1000 x 700 mm (wys. x szer. x głęb.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wolnostojące o gabarytach 900 x 1000 x 700 mm (wys. x szer. x głęb) pod warunkiem zaprojektowania cłego układu do mycia zgodnie z warunkami ergonomii i przepisami BHP.

Pytanie 37 Dotyczy: Załącznik nr 2.18_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Dot. L.p.4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą o wymiarach min.: 170 x 800 x 450 mm (wys. x szer. x głęb.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenie z komorą o wymiarach min.: 170 x 800 x 450 mm (wys. x szer. x głęb.)?

Pytanie 38 Dotyczy: Załącznik nr 2.18_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Dot. L.p.11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zasilaniem elektrycznym jednofazowym 230V/50 Hz, moc zasilania maksimum 3 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z zasilaniem elektrycznym jednofazowym 230V/50 Hz, moc zasilania maksimum 3 kW pod warunkiem zapewnienia zasilenia urządzenia z istniejącej instalacji 230V.

Pytanie 39 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie prostopadłościennej komory o objętości użytkowej wynoszącej 93,4l.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia komorze o pojemności wynoszącej 93,4l. Proponowane rozwiązanie znacząco odbiega od wymaganego.

Pytanie 40 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny komory o wysokości 41cm, spełniającej pozostałe kryteria wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości komory 41cm.

Pytanie 41 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 6

W związku z wymogiem Zamawiającego plazmy generowanej w komorze prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zdjęcie komory lub ewentualnie jej rysunek techniczny obrazujący montaż elektrod w komorze, bez których generacja plazmy w komorze nie jest możliwa.

Odpowiedź:

Spełnienie wymogu na podstawie dokumentów przedmiotowych przedłożonych zgodnie z zapisami SWZ Pkt 12c tiret 1.

Pytanie 42 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie sterylizatora z komorą aluminiową.

Sugerowane rozwiązanie będzie preferować zaoferowanie sterylizatorów plazmowych najnowszej generacji z najbardziej zaawansowanymi parametrami użytkowymi. W najnowszej generacji sterylizatorów plazmowych zdecydowano się zastosować aluminium, które pozwala na efektywniejszą pracę systemów monitorujących przebieg procesu w trakcie trwania cyklu sterylizującego, zapewniające wyższe bezpieczeństwo dla pacjentów i sterylizowanego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora z komorą aluminiową z uwzględnienia użytkowych.

Pytanie 43 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylizatora o wymiarach zewnętrznych: szerokość 77,5 cm, głębokość 109,5 cm, wysokość 180 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że oferowane urządzenie zmieści się w przeznaczonych przestrzeni. Ewentualne zmiany budowlane i instalacyjne po stronie Dostawcy.

Pytanie 44 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 12

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wielkości ekranu dotykowego. Większa przekątna ekranu ma na celu poprawę czytelności prezentowanych danych, ograniczenie ryzyka błędów operatora oraz zwiększenie ergonomii obsługi. Większy ekran umożliwia jednocześnie wyświetlanie kluczowych parametrów procesu sterylizacji, komunikatów systemowych oraz przebiegu cyklu, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa, efektywności pracy i kontroli nad procesem.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametru na:

„Sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej min. 12” po stronie załadowniczej i wyładowniczej”

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje ekranu o przekątnej minimum 7” – zapis jednoznacznie dopuszcza ekran o przekątnej 12”

Pytanie 45 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie do oceny bardziej zaawansowanego rozwiązania technologicznego, które umożliwia nieograniczoną ilościowo archiwizację wykonanych procesów poprzez sieć lub na dysku zewnętrznym z 200 procesami zapisanymi bezpośrednio w sterowniku sterylizatora jako pamięć podręczna. Taka forma archiwizacji zabezpiecza użytkownika przed utratą danych procesowych przy koniecznej wymianie sterownika po awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie 46 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 16

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wbudowanej termicznej drukarki alfanumerycznej zarówno po stronie załadowniczej jak i wyładowniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga drukarki alfanumerycznej po stronie załadowniczej, zamawiający dopuszcza również drukarkę po stronie wyładowniczej

Pytanie 47 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 18

Zwracamy się Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając tylko 3 programów sterylizacyjnych, podczas gdy urządzenia wiodących producentów na rynku oferują już min 4 programy lub więcej. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał sterylizatora plazmowego z min 4 cyklami, najkrótszym o czasie do 25 minut i najdłuższym do 60 minut? Większa ilość dostępnych programów sterylizacyjnych umożliwia szerszy zakres sterylizacji sprzętu i narzędzi obecnych dzisiaj na rynku medycznym. Dostosowanie urządzeń tylko z 3 programami do najnowszych możliwości sterylizacji narzędzi z reguły jest bardzo drogie lub niemożliwe.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametru na:

„Min. 4 programy sterylizacji, w tym program do instrumentów elastycznych”

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje minimum 3 programów sterylizacji, oznacza to że dostawca może dostarczyć urządzenie z 4 lub więcej programami.

Pytanie 48 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zasilania elektrycznego 380-415V, 50-60Hz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilania elektrycznego 400V, 50Hz. Zmiana zasilania na 3 fazowe będzie się wiązać z przeróbkami instalacji w szerszym zakresie niż określono to na rysunku. Dostosowanie instalacji jest po stronie Dostawcy.

Pytanie 49 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy, pkt. 25

Czy Zamawiający zamiast deklaracji zgodności wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia producenta zaoferowanego systemu o zgodności z normą ISO 14937?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga deklaracji zgodności oraz Certyfikatu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO PN-EN ISO 14937

Pytanie 50 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany sterylizator był wskazany w instrukcji użytkowania robota da Vinci jako rekomendowany do sterylizacji endoskopu da Vinci? Na rynku polskim istnieją modele sterylizatorów, które nie są rekomendowane przez firmę Intuitive do sterylizacji optyki da Vinci, a sterylizacja w nich będzie skutkowała utratą gwarancji ze względu na nieprawidłowe procesowanie endoskopu.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 51 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany sterylizator plazmowy umożliwiał sterylizację 2 optyk Da Vinci jednocześnie w dedykowanym do tego programie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 52 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany sterylizator plazmowy był wyposażony w system monitorowania stężenia nadtlenu wodoru (parametr krytyczny procesu sterylizacji w sterylizatorach plazmowych) zainstalowany bezpośrednio w komorze sterylizatora prowadzący nadzór przy pomocy lampy UV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 53 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania sterylizatora plazmowego z bazą danych zawierającą wykaz min. 20 000 urządzeń medycznych zakwalifikowanych do sterylizacji w zaoferowanym sterylizatorze ze wskazaniem wyboru cyklu. Kwalifikacja sprzętu przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych. Narzędzie to umożliwia wybór producenta oraz modelu urządzenia medycznego oraz zawiera min dane dotyczące takich producentów jak: Olympus, Aesculap, Karl Storz, Richard Wolf, Stryker, Intuitive.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 54 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby sterylizator umożliwiał wybór trybu pracy urządzenia ze względu na stężenie czynnika sterylizującego w komorze pomiędzy 58% - 59% H₂O₂ a 80% - 95% H₂O₂?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 55 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 – sterylizator plazmowy

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania sterylizatora wyposażonego w dodatkowy, odrębny cykl kontrolujący poprawność przygotowania wsadu do sterylizacji, informujący użytkownika o jakości załadowanego wsadu, weryfikujący ewentualne pozostałości wilgoci we wsadzie oraz umożliwiający jej eliminację ze wsadu przed uruchomieniem właściwego cyklu sterylizacji o maksymalnym czasie trwania procesu weryfikacji 6 min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 56 Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym

Dot. pkt. 16- Czy Zamawiający dopuści do oceny zgrzewarkę nie wyposażoną w możliwość odwrócenia wydruku o 180st? Rozwiązanie takie nie ma uzasadnienia funkcjonalnego, gdyż łatwiej operatorowi jest obrócić pakiet niż zmieniać ustawienia w zgrzewarce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 57 Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym

Dot. pkt. 17- Czy Zamawiający dopuści do oceny zgrzewarkę wyposażoną w stałą wielkość czcionki? Rozwiązanie takie jest tożsame pod względem funkcjonalnym z opisany, gdyż operator i tak musi przeczytać najmniejsze drukowane przez urządzenie informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez możliwości zmiany czcionek.

Pytanie 58 Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym

Dot. pkt. 18- Czy Zamawiający dopuści do oceny zgrzewarkę, w której dostęp do kasety drukującej wymaga użycia śrubokrętu? Konieczność dostępu do kasety pojawia się zazwyczaj w przypadku ewentualnej awarii urządzenia, przy usunięciu której potrzebne są służby techniczne dysponujące podstawowymi narzędziami

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 59 Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym

Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny zgrzewarkę nie posiadającą możliwości podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej? Oferowane przez nas zgrzewarki wyposażone są w duży, czytelny ekran dotykowy, w którym większość ustawień dokonywana jest poprzez dotknięcie odpowiednich pól, nie ma więc potrzeby dołączania dodatkowej, zewnętrznej klawiatury. Rozwiązanie jest nowocześniejsze niż opisane w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 60 Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym

Dot. pkt. 25- Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli pisząc o modułowym systemie połączeń elektrycznych zespołów. Większość tego typu urządzeń składa się z modułów/podzespołów, które są ze sobą połączone za pomocą przewodów/taśm przesyłających sygnały elektryczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymagając modułowego system połączeń elektrycznych zespołów miał na myśli rozwiązanie konstrukcyjne oparte na gotowych komponentach, które umożliwiają łatwy montaż, demontaż oraz serwisowanie bez konieczności ingerencji w stałą strukturę okablowania urządzenia.

Główne cele takiego wymogu to łatwość serwisowania i napraw. Zastosowanie złącz wtykowych i prefabrykowanych wiązek (zamiast połączeń lutowanych lub bezpośrednich zacisków śrubowych) pozwala na szybką wymianę uszkodzonych podzespołów. Ograniczenie ryzyka błędów montażowych podczas przyszłego serwisowania przez pracowników Szpitala

Pytanie 61 Dotyczy: Załącznik nr 2.1 do SWZ Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym

Dot. pkt. 28- Czy Zamawiający dopuści do oceny zgrzewarkę, której producent nie ma wdrożonego systemu zarządzania ISO9001? Zgrzewarki do rękawów papierowo-foliowych nie są urządzeniami medycznymi i nie ma wymogu posiadania wdrożonego systemu zarządzania jakością przy ich produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgrzewarkę, której producent nie ma wdrożonego systemu zarządzania ISO9001.

Pytanie 62 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SWZ Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy

Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę o wymiarach 33,5cm x 97,2cm x 36,3cm? Oferowany sterylizator posiada komorę pozwalającą na sterylizację znacznie dłuższych przedmiotów niż opisane w SWZ (ponad 97 cm vs. 70cm) i nadaje się do sterylizacji narzędzi laparoskopowych oraz np. optyk do urządzeń robotycznych typu daVinci. Podanych w SWZ wymiarów nie spełniają żadne z najpopularniejszych urządzeń tego typu dostępnych na rynku, odpowiadają natomiast wymiarom komory urządzenia Hyper LTS 150-2 oferowanej przez firmę MMM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 63 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SWZ Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy

Dot. pkt. 5- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w drzwi otwierane i zamykane manualnie, a ryglowane automatycznie? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia z drzwiami otwieranymi i zamykanymi automatycznie, bez konieczności użycia rąk.

Pytanie 64 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SWZ Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy

Dot. pkt. 6- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w generator plazmy? Plazma służy jedynie do usunięcia pozostałości H₂O₂ z komory po procesie, nie ma wpływu na prawidłowość przebiegu procesu sterylizacji. Pod względem funkcjonalnym proponowane rozwiązanie jest identyczne z opisanym w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 65 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SWZ Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy

Dot. pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę wykonaną z aluminium? Rozwiązanie takie zapewnia szybszy transfer energii i przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii przez urządzenie

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 42.

Pytanie 66 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SWZ Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy

Dot. pkt. 9- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o wymiarach 900 x 1.120 x 1.864mm? Podanych w SWZ wymiarów nie spełnia żaden z najpopularniejszych urządzeń tego typu dostępnych na rynku, odpowiadają natomiast wymiarom komory urządzenia Hyper LTS 150-2 oferowanej przez firmę MMM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Ewentualne zmiany budowlane i instalacyjne po stronie Dostawcy.

Pytanie 67 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SWZ Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" umieszczony po stronie załadowniczej oraz wyświetlacz LCD prezentujący najważniejsze parametry programu, umieszczony po stronie rozładowniczej? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 68 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SWZ Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy

Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając aby urządzenie w sterowniku zapisywało min. 15.000 ostatnich cykli sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. Takie wartości oferuje jedynie urządzenie Hyper LTS150-2 firmy MMM. Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator pozwalający na zapis w pamięci sterownika 1.000 ostatnich cykli sterylizacyjnych, co jest wartością więcej niż wystarczającą do prawidłowego funkcjonowania urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej w/w rozwiązanie.

Pytanie 69 Dotyczy: Załącznik nr 2.2 do SWZ Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy

Dot. pkt. 24- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o mocy przyłączeniowej 6,5kW, zasilany prądem 3-fazowym (400V, 50Hz)? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilania elektrycznego 400V, 50Hz. Zmiana zasilania na 3 fazowe będzie się wiązać z przeróbkami instalacji w szerszym zakresie niż określono to na rysunku. Dostosowanie instalacji jest po stronie Dostawcy.

Pytanie 70 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. Pkt. 3- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności 12 STE wyposażony w wózek załadunkowy wyposażony w 2 półki, z czego 1 jest regulowana? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wózka załadunkowego wyposażonego w 2 półki, z czego 1 jest regulowana.

Pytanie 71 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o wysokości załadowniczej 80cm? Po względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie znacznie bardziej ergonomiczne niż opisane w SWZ max. 40cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania, sterylizator ma służyć min. do sterylizacji ciężkich narzędzi, niski poziom załadunku ma ułatwić pracę personelu CS.

Pytanie 72 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o szerokości 996mm wymagający przestrzeni serwisowej min. 600mm co i tak pozwala na ustawienie większej ilości urządzeń w stosunku do wymiarów zewnętrznych podanych w p. 16 SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów Zamawiającego tj. urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych, ustawianie urządzeń jedno obok drugiego, wysokość załadownicza nie więcej niż 40 cm.

Pytanie 73 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w skaner kodów kreskowych podłączony bezpośredni do sterownika urządzenia? W p. 90 załącznika 2.27 dotyczącego Systemu komputerowego do zarządzania CS, Zamawiający wymaga dostarczenia 14 bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych. Wprowadzenie wymogu dodatkowego skanera przewodowego podłączonego do urządzenia nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje wzrost kosztów zakupu i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania oferowane przez jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 74 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w funkcję odtwarzania danych w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta? Utrata danych następują zazwyczaj na skutek awarii urządzenia, co tak czy inaczej powoduje konieczność wezwania serwisu, który przywróci sprawność sterylizatora i sprawdzi bezpieczeństwo jego użytkowania. Wprowadzenie takiego wymogu nie ma więc żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, służy jedynie eliminacji potencjalnych konkurentów

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza, przedmiotowe dane winne być gromadzone równolegle w Systemie Informatycznym który stanowi przedmiot zakupu w niniejszym postępowaniu - Załącznik nr 2.27.

Pytanie 75 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator pozwalający na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 76 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w zintegrowaną drukarkę z wydrukiem zapisu parametrów procesu, z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg wydruku wykresu parametrów cyklu taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 77 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 15- Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg automatycznego wydruku gotowych raportów cyklu na zewnętrznej drukarce nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego gdyż wszystkie informacje będą archiwizowane w dostarczonym systemie. Mając na względzie powyższe, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 15 załącznika 2.3 jako nie mającego żadnego uzasadnienia. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń oferowanych przez firmę MMM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 78 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 16- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności 12 jednostek sterylizacyjnych i wymiarach zewnętrznych 996 x 2.338 x 1.954mm? Oferowane urządzenia mogą zostać swobodnie zainstalowane na terenie projektowanej CS

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza swobodnej lokalizacji urządzeń, powinny one być zabudowane trwale między częścią czystą a sterylną, w kwestii wymiarów całość musi być zaprojektowane ergonomicznie i funkcjonalnie aby nieograniczać wózków załadowniczych i wyładowniczych.

Pytanie 79 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 17- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę sterylizacyjną o pojemności 12 STE i wymiarach 670 x 1.998 x 670mm? Pod względem funkcjonalnym proponowana komora jest identyczna z opisaną w SWZ.

Opisane w p. 17 Załącznika 2.3 wymiary komory odpowiadają wymiarom komory sterylizatora Selectomat 9612 oferowanego przez firmę MMM

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 80 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 18- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzewczy? Rozwiązanie takie jest lepsze od opisanego w p. 18 ze względu na równomierne nagrzewanie się komory, a co za tym idzie eliminację zimnych miejsc w komorze i zapewnienie lepszych (homogenicznych) warunków do zachodzenia procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe wymagania w zakresie wykonania ze stali kwasoodpornej są obowiązujące.

Pytanie 81 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 20- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w automatycznie otwierane i zamykane drzwi komory przesuwne pionowo? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 82 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pneumatyczny napęd drzwi? Jest to rozwiązanie co najmniej tożsame z opisanym w SWZ napędem elektrycznym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 83 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając uszczelnienia drzwi parą pod ciśnieniem? Uszczelki dociskane parą charakteryzują się znacznie niższą trwałością niż takie dociskane powietrzem, co znacząco podnosi koszty eksploatacji urządzenia. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane sterylizatory były wyposażone w uszczelki dociskane sprężonym powietrzem i charakteryzowały się trwałością min. 3.000 cykli sterylizacyjnych, co byłoby potwierdzone stosowną deklaracją producenta urządzenia? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów eksploatacji i konserwacji urządzenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 84 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 28- Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc o programie do sprawdzania prawidłowego usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej, Zamawiający ma na myśli aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w program testowy Bowie&Dick czy też by urządzenie było wyposażone w dodatkowy detektor powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wewnętrznego układu pomiarowego.

Pytanie 85 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 30- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony standardowo w 2 programy testowe (test próżni i test B&D) oraz 5 programów sterylizacyjnych, z możliwością zaprogramowania dodatkowych programów? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 86 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 33- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" umieszczony po stronie załadowniczej? Przy proponowanej szerokości 996mm nie ma fizycznej możliwości umieszczenia ekranu o przekątnej 10" obok komory. Z doświadczenia wiemy, iż ekran 7" jest w zupełności wystarczający do swobodnej obsługi urządzenia, tym bardziej iż w przypadku większego urządzenia opisanego w załączniku 2.12 (myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków) w p. 25 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekrany o przekątnej min. 5"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 87 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 35- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7" umieszczony po stronie załadowniczej? Z doświadczenia wiemy, iż ekran 5,7" po stronie rozładowniczej jest w zupełności wystarczający do swobodnej obsługi urządzenia, tym bardziej iż w przypadku większego urządzenia opisanego w załączniku 2.12 (myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków) w p. 25 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekrany o przekątnej min. 5"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ekranu o przekątnej mniejszej niż 7" po stronie wyladowczej.

Pytanie 88 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. pkt. 42.1- „konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej min. A304., 3 ażurowe półki wózka, jedna lub dwie o regulowanej wysokości położenia”- Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p. 3 Zamawiający dopuści do oceny wózek spełniający wymagania postawione w p. 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 89 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. 42.2- Prosimy o potwierdzenie, iż podana wartość transportu dotyczy w pełni załadowanego wózka wsadowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podana wartość transportu dotyczy wpelni załadowanego wózka wsadowego.

Pytanie 90 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. 42.2- Prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający będzie mierzył prędkość transportu układu rozładunku sterylizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał deklaracji producenta.

Pytanie 91 Dotyczy: Załącznik nr 2.3 do SWZ Sterylizator parowy 12 STE

Dot. 42.3- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc: „tor transportowy połączony ze sterylizatorem na stałe ale umożliwiający podjęcie prac konserwacyjnych”?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje żeby tor transportowy był na stałe połączony ze sterylizatorem podczas eksploatacji w taki sposób żeby umożliwić dostęp do prac konserwacyjnych.

Pytanie 92 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator posiadający dostęp serwisowy z boku? Oferowane przez nas urządzenia należą do najwyższych na rynku i ich szerokość pozwala na ustawienie ich w planowanej CS mimo posiadania przestrzeni serwisowej z boku urządzenia. Przestrzeń taka (wspólna dla dwóch sterylizatorów) służy nie tylko do dostępu serwisowego ale pozwala również na lepsze rozpraszanie ciepła emitowanego przez urządzenia, co ma wpływ na ich mniejszą awaryjność i dłuższy okres użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ewentualne dostosowanie instalacji jest po stronie Dostawcy.

Pytanie 93 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w skaner kodów kreskowych podłączony bezpośredni do sterownika urządzenia? W p. 90 załącznika 2.27 dotyczącego Systemu komputerowego do zarządzania CS, Zamawiający wymaga dostarczenia 14 bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych. Wprowadzenie wymogu dodatkowego skanera przewodowego podłączonego do urządzenia nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje wzrost kosztów zakupu i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania oferowane przez jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 94 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w funkcję odtwarzania danych w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta? Utrata danych następują zazwyczaj na skutek awarii urządzenia, co tak czy inaczej powoduje konieczność wezwania serwisu, który przywróci sprawność sterylizatora i sprawdzi bezpieczeństwo jego użytkowania. Wprowadzenie takiego wymogu nie ma więc żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, służy jedynie eliminacji potencjalnych konkurentów **Odpowiedź:**

Tak zamawiający dopuszcza, przedmiotowe dane winne być gromadzone równolegle w Systemie Informatycznym który stanowi przedmiot zakupu w niniejszym postępowaniu - Załącznik nr 2.27.

Pytanie 95 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator pozwalający na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 96 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w zintegrowaną drukarkę z wydrukiem zapisu parametrów procesu, z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg wydruku wykresu parametrów cyklu taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 97 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 15- Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg automatycznego wydruku gotowych raportów cyklu na zewnętrznej drukarce nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego gdyż wszystkie informacje będą archiwizowane w dostarczonym systemie. Mając na względzie powyższe, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 15 załącznika 2.3 jako nie mającego żadnego uzasadnienia. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń oferowanych przez firmę MMM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 98 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 17- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę sterylizacyjną o wymiarach 670 x 1.296 x 670mm i pojemności 8STE? Oferowane wymiary w minimalnym stopniu (4mm) odbiegają od zapisów SWZ, co nie ma wpływu na jego funkcjonalność. Jednocześnie sterylizator umożliwia sterylizację 8 jednostek wsadowych w jednym cyklu, zgodnie z wymogami p. 1 Załącznika 2.4 do SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 99 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 18- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzewczy? Rozwiązanie takie jest lepsze od opisanego w p. 18 ze względu na równomierne nagrzewanie się komory, a co za tym idzie eliminację zimnych miejsc w komorze i zapewnienie lepszych (homogenicznych) warunków do zachodzenia procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza jako rozwiązanie mniej trwałe.

Pytanie 100 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 20- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pneumatyczny napęd drzwi? Jest to rozwiązanie co najmniej tożsame z opisanym w SWZ napędem elektrycznym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 101 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając uszczelnienia drzwi parą pod ciśnieniem? Uszczelki dociskane parą charakteryzują się znacznie niższą trwałością niż takie dociskane powietrzem, co znacząco podnosi koszty eksploatacji urządzenia. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane sterylizatory były wyposażone w uszczelki dociskane sprężonym powietrzem i charakteryzowały się trwałością min. 3.000 cykli sterylizacyjnych, co byłoby potwierdzone stosowną deklarację producenta urządzenia? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów eksploatacji i konserwacji urządzenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 102 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 27- Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc o programie do sprawdzania prawidłowego usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej, Zamawiający ma na myśli aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w program testowy Bowie&Dick czy też by urządzenie było wyposażone w dodatkowy detektor powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wewnętrznego układu pomiarowego.

Pytanie 103 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt 29- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony standardowo w 2 programy testowe (test próżni i test B&D) oraz 5 programów sterylizacyjnych, z możliwością zaprogramowania dodatkowych programów? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisany w SWZ **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 104 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 32- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" umieszczony po stronie załadowniczej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 105 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 32- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran umieszczony na ergonomicznej wysokości obok komory sterylizacyjnej. Niektórzy producenci umieszczają ekrany sterownika nad komorą sterylizacyjną, przez co są one trudne do obsługi przez osoby niższego wzrostu, a ponadto narażone są na działanie wysokiej temperatury w momencie otwarcia drzwi komory, co może prowadzić do częstszych awarii sterownika, a co za tym idzie wyłączać urządzenie z eksploatacji i narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty. **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 106 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. 34- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7" umieszczony po stronie załadowniczej? Z doświadczenia wiemy, iż ekran 5,7" po stronie rozładowniczej jest w zupełności wystarczający do swobodnej obsługi urządzenia, tym bardziej iż w przypadku większego urządzenia opisanego w załączniku 2.12 (myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków) w p. 25 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekrany o przekątnej min. 5"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ekranu o przekątnej mniejszej niż 7" po stronie wyładowniczej.

Pytanie 107 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. 37- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o mocy maksymalnej 51kW, co nieznacznie odbiega od zapisów SWZ i nie ma wpływu na zużycie energii przez urządzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 108 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 44.2- Prosimy o potwierdzenie, iż podana wartość transportu dotyczy w pełni załadowanego wózka wsadowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że dotyczy w pełni załadowanego wózka wsadowego.

Pytanie 109 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. pkt. 44.2- Prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający będzie mierzył prędkość transportu układu rozładunku sterylizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał deklaracji producenta.

Pytanie 110 Dotyczy: Załącznik nr 2.4 do SWZ Sterylizator parowy 8 STE

Dot. poz. 44.3- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc: „tor transportowy połączony ze sterylizatorem na stałe ale umożliwiający podjęcie prac konserwacyjnych”?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje żeby tor transportowy był na stałe połączony ze sterylizatorem podczas eksploatacji w taki sposób żeby umożliwić dostęp do prac konserwacyjnych.

Pytanie 111 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator posiadający dostęp serwisowy z boku? Oferowane przez nas urządzenia należą do najwęższych na rynku i ich szerokość pozwala na ustawienie ich w planowanej CS mimo posiadania przestrzeni serwisowej z boku urządzenia. Przestrzeń taka (wspólna dla dwóch sterylizatorów) służy nie tylko do dostępu serwisowego ale pozwala również na lepsze rozpraszanie ciepła emitowanego przez urządzenia, co ma wpływ na ich mniejszą awaryjność i dłuższy okres użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ewentualne dostosowanie instalacji jest po stronie Dostawcy.

Pytanie 112 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w skaner kodów kreskowych podłączony bezpośredni do sterownika urządzenia? W p. 90 załącznika 2.27 dotyczącego Systemu komputerowego do zarządzania CS, Zamawiający wymaga dostarczenia 14 bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych. Wprowadzenie wymogu dodatkowego skanera przewodowego podłączonego do urządzenia nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje wzrost kosztów zakupu i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania oferowane przez jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 113 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w funkcję odtwarzania danych w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta? Utrata danych następują zazwyczaj na skutek awarii urządzenia, co tak czy inaczej powoduje konieczność wezwania serwisu, który przywróci sprawność sterylizatora i sprawdzi bezpieczeństwo jego użytkowania. Wprowadzenie takiego wymogu nie ma więc żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, służy jedynie eliminacji potencjalnych konkurentów

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza, przedmiotowe dane winne być gromadzone równolegle w Systemie Informatycznym który stanowi przedmiot zakupu w niniejszym postępowaniu - Załącznik nr 2.27.

Pytanie 114 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator pozwalający na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu

do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 115 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w zintegrowaną drukarkę z wydrukiem zapisu parametrów procesu, z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg wydruku wykresu parametrów cyklu taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 116 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 15- Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg automatycznego wydruku gotowych raportów cyklu na zewnętrznej drukarce nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego gdyż wszystkie informacje będą archiwizowane w dostarczonym systemie. Mając na względzie powyższe, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 15 załącznika 2.3 jako nie mającego żadnego uzasadnienia. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń oferowanych przez firmę MMM

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 117 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 16- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o wymiarach 996 x 1.336 x 1.954mm, co nieznacznie odbiega od zapisu SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 118 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 18- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzewczy? Rozwiązanie takie jest lepsze od opisanego w p. 18 ze względu na równomierne nagrzewanie się komory, a co za tym idzie eliminację zimnych miejsc w komorze i zapewnienie lepszych (homogenicznych) warunków do zachodzenia procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza jako rozwiązanie mniej trwałe.

Pytanie 119 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w pneumatyczny napęd drzwi? Jest to rozwiązanie co najmniej tożsame z opisanym w SWZ napędem elektrycznym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 120 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając uszczelnienia drzwi parą pod ciśnieniem? Uszczelki dociskane parą charakteryzują się znacznie niższą trwałością niż takie dociskane powietrzem, co znacząco podnosi koszty eksploatacji urządzenia. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane

sterylizatory były wyposażone w uszczelki dociskane sprężonym powietrzem i charakteryzowały się trwałością min. 3.000 cykli sterylizacyjnych, co byłoby potwierdzone stosowną deklarację producenta urządzenia? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów eksploatacji i konserwacji urządzenia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 121 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 28- Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc o programie do sprawdzania prawidłowego usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej, Zamawiający ma na myśli aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w program testowy Bowie&Dick czy też by urządzenie było wyposażone w dodatkowy detektor powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wewnętrznego układu pomiarowego.

Pytanie 122 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 30- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony standardowo w 2 programy testowe (test próżni i test B&D) oraz 5 programów sterylizacyjnych, z możliwością zaprogramowania dodatkowych programów? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 123 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 33- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7” umieszczony po stronie załadowniczej? **Odpowiedź:**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 124 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 33- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran umieszczony na ergonomicznej wysokości obok komory sterylizacyjnej. Niektórzy producenci umieszczają ekrany sterownika nad komorą sterylizacyjną, przez co są one trudne do obsługi przez osoby niższego wzrostu, a ponadto narażone są na działanie wysokiej temperatury w momencie otwarcia drzwi komory, co może prowadzić do częstszych awarii sterownika, a co za tym idzie wyłączać urządzenie z eksploatacji i narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 125 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 35- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7” umieszczony po stronie załadowniczej? Z doświadczenia wiemy, iż ekran 5,7” po stronie rozładowniczej jest w zupełności wystarczający do swobodnej obsługi urządzenia, tym bardziej iż w przypadku większego urządzenia opisanego w załączniku 2.12 (myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków) w p. 25 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekrany o przekątnej min. 5”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ekranu o przekątnej mniejszej niż 7” po stronie wyładowniczej.

Pytanie 126 Dotyczy: Załącznik nr 2.5 do SWZ Sterylizator parowy 4 STE

Dot. pkt. 38- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o mocy maksymalnej 39kW, co nieznacznie odbiega od zapisów SWZ i nie ma wpływu na zużycie energii przez urządzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 127 Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SWZ Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając szafy 1-drzwiowej? Centralna Sterylizatornia podzielona jest na strefy, w których urządzenia pełnią rolę śluz i z tego powodu są urządzeniami przelotowymi (2-drzwiowymi). Dostarczenie szafy 1-drzwiowej spowoduje, iż endoskopy będą umieszczane i wyjmowane w tej samej strefie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 128 Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SWZ Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. pkt. 7- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając aby szafa do przechowywania endoskopów była połączona z systemem zarządzania obrotem narzędzi w CS? Szafy endoskopowe zazwyczaj są urządzeniami użytkowymi w pracowniach endoskopowych więc są podłączone do systemu badań endoskopowych. Podłączenie do systemu zarządzania obrotem narzędzi w CS nie pozwala na połączenie jej z systemem badań endoskopowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 129 Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SWZ Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, której kosze załadowcze nie są kompatybilne z oferowaną myjnią endoskopową? Na rynku jest niewielu producentów myjni endoskopowych, które wyposażone są w kosze umożliwiające umieszczenie ich potem w szafach. Wprowadzenie takiego wymogu ogranicza konkurencję i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 130 Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SWZ Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. pkt. 13- Czy Zamawiający pisząc o możliwości ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych ma na myśli by szafa identyfikowała użytkownika na podstawie przypisanych kart RFID i tylko w takim przypadku pozwalała na wyjęcie/umieszczenie endoskopu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 131 Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SWZ Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. pkt. 14- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby szafa w sposób jednoznaczny, kolorami na ekranie sterownika, informowała o aktualnych statusie poszczególnych endoskopów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 132 Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SWZ Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. pkt. 15- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby powietrze do suszenia kanałów było filtrowane filtrem max. 0,03µm, co gwarantuje zatrzymanie nawet drobnych cząsteczek zanieczyszczeń

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 133 Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SWZ Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, która nie jest połączona z oferowaną myjnią endoskopową? Na rynku jest wielu producentów myjni oraz szaf. Wprowadzenie takiego wymogu oznacza konieczność zaoferowania myjni i szafy pochodzących od jednego producenta, zamiast najlepszego rozwiązania. Zapis taki dodatkowo ogranicza konkurencję i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 134 Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SWZ Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający uzna warunek p. 22 za spełniony jeśli zaoferowana szafa będzie wyposażona we wbudowaną drukarkę? Jest to rozwiązanie lepsze pod względem funkcjonalnym od opisanego w SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 135 Dotyczy: Załącznik nr 2.6 do SWZ Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

Dot. pkt. 25- Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o wymiarach 720 x 610 x 1.850mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SWZ?

Odpowiedź:

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne: urządzenie nie większe niż: 700 mm szerokość, 2000 mm wysokość i 600 mm głębokość

Pytanie 136 Dotyczy: Załącznik nr 2.7 do SWZ Szafa do suszenia narzędzi

Dot. pkt. 3- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając by konstrukcja zaoferowanej suszarki spełniała wymagania normy PN-EN ISO 15883? Norma ta dotyczy myjni-dezynfektorów, a nie suszarek narzędziowych

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia normy PN EN ISO 15883 dla asortymentu opisanego w Załączniku nr 2.7. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść:

- *Załącznika nr 2.7_ Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia narzędzi poprzez wykreślenie Pkt. 3.*
- *SWZ Pkt 12 c tiret 6 który otrzymuje brzmienie:*

„Certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO PN -EN ISO 15883 dla Załącznika 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, ~~2.11~~, 2.12, ~~2.18~~”

Pytanie 137 Dotyczy: Załącznik nr 2.7 do SWZ Szafa do suszenia narzędzi

Dot. pkt. 5- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę wyposażoną w 9 półek na tace narzędziowe? Nowoczesne myjnie-dezynfektory wiodących producentów dosuszają myte narzędzia i nie wymagają stosowania suszarek, dlatego też suszarka w nowoczesnej CS pełni rolę uzupełniającą i różnica 1 tacy

narzędziowej nie jest istotna z punktu widzenia reprocessowania narzędzi, zwłaszcza, iż wymagane przez Zamawiającego myjnie mają pojemność min. 15 tac,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 138 Dotyczy: Załącznik nr 2.7 do SWZ Szafa do suszenia narzędzi

Dot. pkt. 10- Prosimy o potwierdzenie, iż pisząc o powietrzu filtrowanym Zamawiający ma na myśli by układ suszenia był wyposażony w filtr absolutny HEPA klasy min. H14. Określenie „powietrze filtrowane” można rozumieć jako przepuszczone przez dowolny filtr, co nie gwarantuje zachowania czystości mikrobiologicznej umieszczonych w suszarce przedmiotów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 139 Dotyczy: Załącznik nr 2.7 do SWZ Szafa do suszenia narzędzi

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę wyposażoną w możliwość regulacji czasu suszenia w zakresie 30 – 120min? Suszarki w nowoczesnych CS służą co najwyżej do dosuszania narzędzi o bardzo skomplikowanych kształtach i wymaganie by można było regulować czas suszenia w zakresie 1 – 99min nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 140 Dotyczy: Załącznik nr 2.7 do SWZ Szafa do suszenia narzędzi

Dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę wyposażoną w możliwość regulacji temperatury suszenia w zakresie 35 - 80°C? W przypadku suszenia narzędzi istotniejsza jest możliwość nastawienia niższej temperatury suszenia, tak by nie uszkodzić narzędzi termolabilnych, niż ciut wyższa temperatura maksymalna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 141 Dotyczy: Załącznik nr 2.7 do SWZ Szafa do suszenia narzędzi

Dot. pkt. 17- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę o wymiarach zewnętrznych 750x1994x993mm SxWxG co nieznacznie odbiega od zapisów SWZ?

Odpowiedź:

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne: urządzenie nie większe niż: 700 mm szerokość, 2500 mm wysokość i 450 mm głębokość

Pytanie 142 Dotyczy: Załącznik nr 2.7 do SWZ Szafa do suszenia narzędzi

Dot. pkt. 18- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zasileniem 4kW/230V co nieznacznie odbiega od postawionego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 143 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. poz. 1- Ponieważ w załącznikach 2.71 oraz 2.72 do SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia tac sterylizacyjnych zgodnych z wymiarami 1/1 oraz 1/2 DIN prosimy o korektę zapisu p. 1 załącznika 2.8 na „Urządzenie o pojemności komory umożliwiające mycia i dezynfekcję nie mniej niż 15 sztuk tac instrumentowych o wymiarach zgodnych z 1/1 DIN lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE z pokrywami”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 144 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. poz. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pozwalającą na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 145 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. poz. 11- Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg automatycznego wydruku gotowych raportów cyklu na zewnętrznej drukarce nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego gdyż wszystkie informacje będą archiwizowane w dostarczonym systemie. Mając na względzie powyższe, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 11 załącznika 2.8 jako nie mającego żadnego uzasadnienia. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń oferowanych przez firmę MMM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 146 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. poz. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach zewnętrznych 820 x 936 x 2.450mm? Dzięki mniejszej szerokości możliwe jest ustawienie większej ilości myjni na tej samej szerokości pomieszczenia, a co za tym idzie łatwe zwiększenie wydajności CS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 147 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. poz. 23- Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania myjni wyposażonej w system przyłączy wózków do systemu cyrkulacyjnego umieszczonych po 2 stronach komory. Opisany system jest to tzw. system Janus oferowany w myjniach firmy MMM. Wprowadzenie takiego wymogu uniemożliwia złożenie oferty na urządzenia innego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 148 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. pkt. 30- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w suszarkę z elementem nawiewnym? Wymaganie konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 149 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. pkt. 34- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w oświetlenie LED komory mycia i sygnalizację stanu urządzenia na ekranie wyświetlacza? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 150 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. pkt. 36- Ponieważ na rynku Polskim mamy obecne narzędzia robotyczne co najmniej 3 producentów prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzeń wszystkich obecnych na rynku producentów narzędzi robotycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 151 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. pkt. 36- Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w p. 36 w przypadku dołączenia do oferty potwierdzenie o kompatybilności oferowanej myjni z narzędziami robotycznymi różnych producentów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 152 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. pkt. 38- Ponieważ w CS wykonywane są procesy mycia i dezynfekcji różnych narzędzi, wymagających różnych parametrów mycia, zaś systemy automatycznego rozpoznawania wózka wsadowego mają możliwość przypisania tylko jednego programu do danego wózka prosimy o odstąpienie od wymogu p. 38 jako powodującego później problemy w trakcie pracy w CS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 153 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Dot. pkt. 41- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy przyłączeniowej 25kW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Dostosowanie instalacji jest po stronie Dostawcy.

Pytanie 154 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Ponieważ w p. 20 i 21 Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w dodatkowe zbiorniki wody, to czy Zamawiający wymaga aby myjnia wykonywała tzw. Szybki cykl, tj. by długość trwania programu mycia z dezynfekcją termiczną dla $A_0=3.000$ nie przekraczała 50 min, co byłoby potwierdzone na załączonym do oferty wydruku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 155 Dotyczy: Załącznik nr 2.8 do SWZ Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN

Mając na względzie przyszłe koszty eksploatacji urządzenia, czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia charakteryzowała się niską energochłonnością i zużywała nie więcej niż 25l wody na fazę cyklu? Zużycie wody ma największe znaczenie dla kosztów eksploatacji, gdyż wpływa na zużycie energii elektrycznej oraz środków chemicznych. Mając na uwadze, iż Zamawiający ma zamiar zakupić min. 4 szt myjni zużycie wody będzie miało ogromny wpływ na koszty późniejszej eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 156 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Wnosimy o dopuszczenie, na zasadzie równoważności, konfiguracji obejmującej dwie myjnie o pojemności 15 tac każda w miejsce jednej myjni o pojemności 30 tac opisanej w Załączniku 2.9.

W Załączniku 2.9 Zamawiający opisał parametry myjni o pojemności 30 tac, przy czym wymagania te spełnia wyłącznie urządzenie Uniclean PL II 30 firmy MMM. Jednocześnie, zgodnie z Załącznikiem nr 2, Zamawiający oczekuje dostawy łącznie urządzeń o pojemności 90 tac (tj. 4 myjnie o pojemności 15 tac oraz 1 myjnia o pojemności 30 tac).

W Załączniku 2.9 oraz Załączniku 2.8, w pkt. 12, określono wymiary przestrzeni przeznaczonej pod montaż myjni jako 5.000 mm (4 × 1.000 mm dla myjni 15-tacowych oraz 1 × 1.000 mm dla myjni 30-tacowej).

Proponowane przez nas myjnie Matachana MAT LD1000 o pojemności 15 tac mają szerokość jedynie 820 mm, co umożliwia instalację 6 urządzeń w dostępnej przestrzeni 5.000 mm. Oznacza to, że oferowana konfiguracja 6 × 15 tac zapewnia identyczną łączną wydajność 90 tac w jednym cyklu, całkowicie zgodną z wymaganiami Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów użytkowych i eksploatacyjnych.

Podkreślamy, że pozostawienie wymogu o dostarczeniu myjni o pojemności 30 tac w konfiguracji opisanej w Załączniku 2.9 powoduje, że spełnienie tego warunku jest możliwe wyłącznie przy użyciu urządzenia jednego producenta, co ogranicza konkurencję, narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz nieuzasadnienie zawęży rynek możliwych rozwiązań, mogąc prowadzić do zwiększenia kosztów zakupu oraz eksploatacji urządzeń.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego, zaoferowania dwóch myjni o pojemności 15 tac w miejsce jednej myjni o pojemności 30 tac. Proponowana konfiguracja spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie pojemności, wydajności oraz dostępnej przestrzeni instalacyjnej, jednocześnie zapewniając konkurencyjność postępowania.

Dodatkowo opisana myjnia Uniclean PL II 30 firmy MMM, wyposażona zgodnie zapisami p. 57 i 58 załącznika 2.9 w automatyczne systemy załadownicze i rozładownicze, będzie zajmowała min. 5.110mm na głębokość (1.778mm głębokość urządzenia oraz 2 x min. 833mm (głębokość wózka wsadowego) system załadowniczy i 2 x min. 833mm (głębokość wózka wsadowego) system rozładowniczy). Tak wielkie urządzenie będzie niekorzystnie wpływało na ergonomię pracy w CS, zwłaszcza, że stojące obok myjnie o pojemności 15 tac będą zajmowały dwukrotnie mniej miejsca. Dlatego też proponowane przez nas rozwiązanie polegające na zaoferowaniu 6 myjni 15 tacowej jest znacznie wygodniejsze niż opisane w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku nr 2.9 do SWZ. W miejsce urządzenia opisanego w Załączniku 2.9 do SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch myjni o pojemności 15 tac – zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku 2.8 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:

- 1. Treść załącznika nr 2.9 poprzez wykreślenie punktów 1 do 43, modyfikację ilości i nadania nowej nazwy tj. Załącznik nr 2.9 do SWZ - Komplet wyposażenia dla 6 myjni.***
- 2. Jednocześnie wykreśla się z Załącznika nr 2.14 do SWZ z nazwy oraz z Pkt. 5 Załącznika nr 2.14 wymóg dostarczenia ramp dla myjni-dezynfektora 30 tac. Pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„rampa kompatybilna z wózkami załadowniczymi i transportowymi oferowanych myjni 15 tac”***
- 3. Treść załącznika nr 2.8 poprzez zmianę zapisów w Pkt 1.(rozmiary tac)***
- 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy - w Pozycji 0.78 Strefa brudna pkt 1 poprzez zamianę liczby urządzeń z 4 szt. na 6 szt. i wpisanie w pozycji pkt 0.78 Strefa brudna pkt 2 nowej nazwy (zgodnie z modyfikacją) tj. Komplet wyposażenia dla 6 myjni.***
- 5. Treść SWZ w Pkt 12c tiret 2 i tiret 6 poprzez wykreślenie załącznika 2.9.***

Dostosowanie pomieszczenia i ilości przyłączy zostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie 157 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 1- Ponieważ w załącznikach 2.71 oraz 2.72 do SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia tac sterylizacyjnych zgodnych z wymiarami 1/1 oraz 1/2 DIN prosimy o korektę zapisu p. 1 załącznika 2.8 na „Urządzenie o pojemności komory umożliwiające mycia i dezynfekcję nie mniej niż 15 sztuk tac instrumentowych o wymiarach zgodnych z 1/1 DIN lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE z pokrywami”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią i modyfikacją na pytanie 157

Pytanie 158 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pozwalającą na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 159 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

4 Dot. pkt. 11- Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg automatycznego wydruku gotowych raportów cyklu na zewnętrznej drukarce nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego gdyż wszystkie informacje będą archiwizowane w dostarczonym systemie. Mając na względzie powyższe, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 11 załącznika 2.8 jako nie mającego żadnego uzasadnienia. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń oferowanych przez firmę MMM.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 160 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach zewnętrznych 820 x 936 x 2.450mm? Dzięki mniejszej szerokości możliwe jest ustawienie większej ilości myjni na tej samej szerokości pomieszczenia, a co za tym idzie łatwe zwiększenie wydajności CS.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 161 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści do oceny dwie myjnie wyposażone w komory o wymiarach zewnętrznych 708 x 845 x 740mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 162 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 23- Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania myjni wyposażonej w system przylączy wózków do systemu cyrkulacyjnego umieszczonych po 2 stronach komory. Opisany system jest to tzw. system Janus oferowany w myjniach firmy MMM. Wprowadzenie takiego wymogu uniemożliwia złożenie oferty na urządzenia innego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 163 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 30- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w suszarkę z elementem nawiewnym? Wymaganie konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta, co stanowi ograniczenie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 164 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 34- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w oświetlenie LED komory mycia i sygnalizację stanu urządzenia na ekranie wyświetlacza? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 165 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 36- Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób myjnia wyposażona w komorę o głębokości min. 1.600mm, obsługująca wózki o głębokości 833mm może być używana jako śluza?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 166 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 37- Ponieważ w CS wykonywane są procesy mycia i dezynfekcji różnych narzędzi, wymagających różnych parametrów mycia, zaś systemy automatycznego rozpoznawania wózka wsadowego mają możliwość przypisania tylko jednego programu do danego wózka prosimy o odstąpienie od wymogu p. 38 jako powodującego później problemy w trakcie pracy w CS.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 167 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 38- Ponieważ na rynku Polskim mamy obecne narzędzia robotyczne co najmniej 3 producentów prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzeń wszystkich obecnych na rynku producentów narzędzi robotycznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 168 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 38- Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w p. 36 w przypadku dołączenia do oferty potwierdzenie o kompatybilności oferowanej myjni z narzędziami robotycznymi różnych producentów?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 169 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 41- Czy Zamawiający dopuści do oceny 2 myjnie o mocy przyłączeniowej 25kW każda?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 170 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. „Komplet wyposażenia dla 5 myjni:”- Prosimy o przydzielenie wózków osobno do myjni 15 oraz 30 tacowej. W obecnej formie zapisy spełniają tylko myjnie Uniclean PL II 15 oraz 30 oferowane przez firmę MMM

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 157 i modyfikacją.

Pytanie 171 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt 45- Ponieważ w załącznikach 2.71 oraz 2.72 do SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia tac sterylizacyjnych zgodnych z wymiarami 1/1 oraz 1/2 DIN prosimy o korektę zapisu p.45 na Wózek załadowniczy na 6 szt. tac o wymiarach zgodnych z 1/1 DIN – 2 szt. oraz o doprecyzowanie ilu poziomowy ma być zaoferowany wózek.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią i modyfikacją na pytanie 157. Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt 2 Załącznika nr 2.9 do SWZ tj. tace o wymiarach w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ i wysokości 165 mm.

Pytanie 172 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 46- Ponieważ w załącznikach 2.71 oraz 2.72 do SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia tac sterylizacyjnych zgodnych z wymiarami 1/1 oraz 1/2 DIN prosimy o korektę zapisu p.46 na: Wózek załadowniczy na nie mniej niż 15 tac zgodnych z 1/1 DIN, wyposażony w min. 2 złącza typu Luer na każdym poziomie umożliwiające podłączenie adapterów do mycia narzędzi laparoskopowych. 2 adaptery po min. 7 przyłączy – 2 szt.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią i modyfikacją na pytanie 157. Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt 3 Załącznika nr 2.9 do SWZ tj. tace o wymiarach w zakresie długości, szerokości i wysokości zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ

Pytanie 173 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 47- Ponieważ w załącznikach 2.71 oraz 2.72 do SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia tac sterylizacyjnych zgodnych z wymiarami 1/1 oraz 1/2 DIN prosimy o korektę zapisu p. 47 na: Wózek załadowniczy na 12 tac o wymiarach zgodnych z 1/1 DIN, wyposażony w min. 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym – 2 szt.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią i modyfikacją na pytanie 157. Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt 4 Załącznika nr 2.9 do SWZ tj. tace o wymiarach w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ i wysokości 100 mm.

Pytanie 174 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 48- Ponieważ w załącznikach 2.71 oraz 2.72 do SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia tac sterylizacyjnych zgodnych z wymiarami 1/1 oraz 1/2 DIN prosimy o korektę zapisu p.48 na: Wózek załadowniczy do mycia 6 tac o wymiarach zgodnych z 1/1 DIN, wyposażony w min. 90 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym – 1 szt

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią i modyfikacją na pytanie 157. Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt 4 Załącznika nr 2.9 do SWZ tj. tace o wymiarach w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ i wysokości 80/140 mm. w ilości 2 szt.

Pytanie 175 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 52- Ponieważ w Polsce obecnych jest min. 3 producentów robotycznych systemów chirurgicznych prosimy o doprecyzowanie, do którego robota (producent i model) należy dostarczyć kosz do mycia narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 176 Dotyczy: Załącznik nr 2.9 do SWZ Myjnia-dezynfektor 30 tac DIN

Dot. pkt. 57- Czy w przypadku wyrażenia zgody na dostarczenie w zamian za myjnię 30 tacową 2 myjni po 15 tac Zamawiający oczekuje dostarczenia dodatkowych systemów załadowniczych/rozładowniczych do myjni 15 tacowych w miejsce systemów załadowniczych/rozładowniczych do myjni 30 tacowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157 Zamawiający rezygnuje z dostarczenia Myjni opisanej w Załączniku 2.9 do SWZ.

Pytanie 177 Dotyczy: Załącznik nr 2.10 do SWZ Myjnia-dezynfektor przelotowa na jeden endoskop elastyczny

Dot. pkt. 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię 1-drzwiową, nieprzelotową? Myjnia endoskopowa w CS obsługuje niewielkie ilości narzędzi endoskopowych. Większość używanych w pracowniach endoskopowych, trafia do myjni umieszczonych w ich pobliżu. Ponieważ na rynku dostępne jest tylko kilka myjni na 1 endoskop w wersji przelotowej, wprowadzenie takiego wymogu ogranicza konkurencję i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SWZ zamawiający wymaga takiego rozwiązania przelotowego

Pytanie 178 Dotyczy: Załącznik nr 2.10 do SWZ Myjnia-dezynfektor przelotowa na jeden endoskop elastyczny

Dot. pkt. 9- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w skaner kodów kreskowych podłączony bezpośredni do sterownika urządzenia? W p. 90 załącznika 2.27 dotyczącego Systemu komputerowego do zarządzania CS, Zamawiający wymaga dostarczenia 14 bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych. Wprowadzenie wymogu dodatkowego skanera przewodowego podłączonego do urządzenia nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje wzrost kosztów zakupu i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania oferowane przez jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 179 Dotyczy: Załącznik nr 2.10 do SWZ Myjnia-dezynfektor przelotowa na jeden endoskop elastyczny

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażony w funkcję odtwarzania danych w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta? Utrata danych następują zazwyczaj na skutek awarii urządzenia, co tak czy inaczej powoduje konieczność wezwania serwisu, który przywróci sprawność sterylizatora i sprawdzi bezpieczeństwo jego użytkowania. Wprowadzenie takiego wymogu nie ma więc żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, służy jedynie eliminacji potencjalnych konkurentów

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza, przedmiotowe dane winne być gromadzone równolegle w Systemie Informatycznym który stanowi przedmiot zakupu w niniejszym postępowaniu - Załącznik nr 2.27.

Pytanie 180 Dotyczy: Załącznik nr 2.10 do SWZ Myjnia-dezynfektor przelotowa na jeden endoskop elastyczny

Dot. pkt. 13- Prosimy o podanie producentów oraz modeli endoskopów dla których mają być dostarczone przyłącza

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli informacji po wyborze Dostawcy wyposażenia CS

Pytanie 181 Dotyczy: Załącznik nr 2.10 do SWZ Myjnia-dezynfektor przelotowa na jeden endoskop elastyczny

Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w drzwi otwierane manualnie, po otwarciu tworzące wygodny stolik do załadunku kosza na endoskop?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 182 Dotyczy: Załącznik nr 2.10 do SWZ Myjnia-dezynfektor przelotowa na jeden endoskop elastyczny

Dot. pkt. 37- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 3-fazowym (400V, 50Hz)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Dostosowanie instalacji jest po stronie Dostawcy.

Pytanie 183 Dotyczy: Załącznik nr 2.11 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca

Dot. pkt. 2- Ponieważ myjnie ultradźwiękowe w większości nie są Wyrobami Medycznymi prosimy o odstąpienie od wymogu p. 2 Załącznika 2.11 do OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 184 Dotyczy: Załącznik nr 2.11 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy ultradźwiękowej 2.200W? Wyższa moc ultradźwięków umożliwia uzyskiwanie lepszych rezultatów mycia w krótszym czasie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 185 Dotyczy: Załącznik nr 2.11 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca

Dot. pkt. 11- Ponieważ podane w p. 11 normy z serii PN-EN ISO 15883 dotyczą myjni-dezynfektorów, a nie myjni ultradźwiękowych, prosimy o wykreślenie p. 11 jako nie mającego zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu spełnienia normy PN EN ISO 15883 dla asortymentu opisanego w Załączniku nr 2.11 Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść:

- *Załącznika nr 2.11_ Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca poprzez wykreślenie punktu 11.*

- *SWZ Pkt 12 c tiret 6 który otrzymuje brzmienie:*

„Certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO PN -EN ISO 15883 dla Załącznika 2-7, 2.8, 2.9, 2.10, 2-11, 2.12, 2.18”

Pytanie 186 Dotyczy: Załącznik nr 2.11 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca

Dot. pkt. 12- Ponieważ myjnie ultradźwiękowe w większości nie są Wyrobami Medycznymi ich producenci nie muszą mieć wdrożonego systemu zarządzania jakością dotyczącego wyrobów medycznych. Mając na względzie powyższe prosimy o odstąpienie od wymogu p. 12 Załącznika 2.11 do OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeżeli urządzenie nie jest wyrobem medycznym.

Pytanie 187 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie nie wyposażoną w skaner kodów kreskowych podłączony bezpośredni do sterownika urządzenia? W p. 90 załącznika 2.27 dotyczącego Systemu komputerowego do zarządzania CS, Zamawiający wymaga dostarczenia 14 bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych. Wprowadzenie wymogu dodatkowego skanera przewodowego podłączonego do urządzenia nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje wzrost kosztów zakupu i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania oferowane przez jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 188 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w funkcję odtwarzania danych w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta? Utrata danych następują zazwyczaj na skutek awarii urządzenia, co tak czy inaczej powoduje konieczność wezwania serwisu, który przywróci sprawność sterylizatora i sprawdzi bezpieczeństwo jego użytkowania. Wprowadzenie takiego wymogu nie ma więc żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, służy jedynie eliminacji potencjalnych konkurentów **Odpowiedź:**

Tak zamawiający dopuszcza, przedmiotowe dane winne być gromadzone równolegle w Systemie Informatycznym który stanowi przedmiot zakupu w niniejszym postępowaniu - Załącznik nr 2.27.

Pytanie 189 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator pozwalający na archiwizację i wydruk ostatniego 1000 procesów sterylizacyjnych? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 190 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w zintegrowaną drukarkę z wydrukiem zapisu parametrów procesu, z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami systemu do komputerowej rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji więc wymóg wydruku wykresu parametrów cyklu taki nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 191 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 16- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w otwierane manualnie, zamocowane na zawiasach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z zapisami OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 192 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w zbiornik roztworów roboczych o pojemności 100l? Oferowana przez nas myjnia zużywa znacznie mniej wody na każdą fazę cyklu, posiadanie tak dużego zbiornika i podgrzewanie w nim wody nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. Generuje za to znaczne koszty eksploatacyjne dla Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 193 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanej o pojemności 100l? Oferowana przez nas myjnia zużywa znacznie mniej wody na fazę cyklu i tak wielki zbiornik nie ma żadnego uzasadnienia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 194 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 25- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając ekranów o przekątnej 5"? W tak dużych urządzeniach jak myjnie do kontenerów i wózków stosowane są znacznie większe ekrany sterownika, o przekątnej 7 – 10

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 195 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 36- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w dysze natryskowe, których ruch odbywa się w płaszczyźnie pionowej? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z opisanym w OPZ i nie ma wpływu na skuteczność procesu mycia. Wymaganie konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych jednoznacznie wskazuje na urządzenia jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 196 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 39- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dopuszczając urządzenia o mocy 130kW? Myjnie tego typu wiodących producentów wymagają przyłącza poniżej 100kW, co ma potem swoje odzwierciedlenie w zużyciu energii przez urządzenie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 197 Dotyczy: Załącznik nr 2.12 do SWZ Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

Dot. pkt. 43.1- Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek o pojemności 12 pojemników sterylizacyjnych wielkości 1STE wraz z pokrywami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 198 Dotyczy: Załącznik nr 2.18 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Dot. poz. 1- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia wolnostojącego czy też zabudowanego w szafkę

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga funkcjonalności zgodnej z punktem 1.

Pytanie 199 Dotyczy: Załącznik nr 2.18 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Dot. poz. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach komory 165 x 420 x 770mm, co umożliwia swobodnie mycie narzędzi robotycznych np. systemu daVinci Xi

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 200 Dotyczy: Załącznik nr 2.18 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Dot. poz. 8- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając aby zaoferowana myjnia była wyposażona w komorę wykonaną ze stali klasy X5CrNi18-10? Jest to podstawowy rodzaj stali kwasoodpornej. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w komorę wykonaną ze znacznie lepszego gatunku stali X5CrNiMo17-12-2, co jest rozwiązaniem dużo lepszym niż opisane w OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 201 Dotyczy: Załącznik nr 2.18 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Dot. poz. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy przyłączeniowej 3kW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 202 Dotyczy: Załącznik nr 2.18 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia umożliwiała ruch końcówek dystalnych narzędzi daVinci serii Xi, co gwarantuje domywanie nawet trudno dostępnych części narzędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 203 Dotyczy: Załącznik nr 2.18 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia monitorowała przepływ roztworu w podłączonych kanałach narzędzi, tak aby uniknąć ich uszkodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 204 Dotyczy: Załącznik nr 2.18 do SWZ Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia zastępowała pracochłonne wstępne czyszczenie manualne narzędzi daVinci, co byłoby potwierdzone specjalnym oświadczeniem producenta

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 205 Dotyczy: Dotyczy warunków udziału w postępowaniu:

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca posiada właściwe zdolności techniczne lub zawodowe rozumiane jako – zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowę/umowy, której/których zakres obejmował dostawę/dostawy wyposażenia/systemu do Centralnej Sterylizatorni w szczególności :

urządzeń sterylizujących takich jak sterylizator parowy 2 szt., sterylizator plazmowy 1 szt. oraz wyposażenie pracowni meblowe ze stali systemowej, o wartości zrealizowanej umowy brutto minimum 2 500 000,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 206 Dotyczy: Załącznik nr 2.52 _Opis Parametrów Technicznych Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku

Pyt. 1

Dot. pkt. 7


Prosimy o możliwość zaoferowania produktu którego producent nie posiada certyfikatu PN-EN ISO 9001 (lub innego równoważnego).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 207 Dotyczy: Załącznika nr 2.25 Zestaw dezynfekcyjny

Prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie zestawu dezynfekcyjnego dla którego wymagania określono w załączniku 2.25. Czy Zamawiający dopuści dozownik renomowanego producenta w którym duży przycisk dozowania mydła jest umieszczony **na przedniej pokrywie** i umożliwia dozowanie łokciem, bez użycia dłoni np:

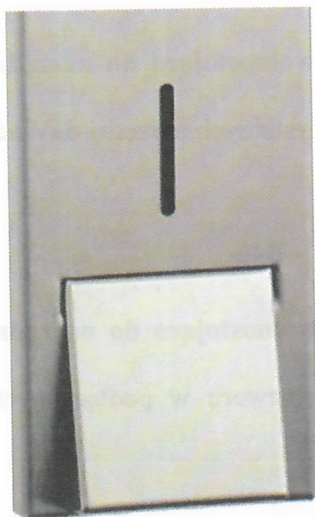

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 208 Dotyczy: Załącznika nr 2.25 Zestaw dezynfekcyjny

Prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie zestawu dezynfekcyjnego dla którego wymagania określono w załączniku 2.25. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na ręczniki papierowe renomowanego producenta o wymiarach **wysokość 26,5 cm, szerokość 25,5 cm, głębokość 12 cm**. Jest to standardowy wymiar ręczników jednorazowych składanych w "V".

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 209 Dotyczy: Załącznika nr 2 .16 Dozownik płynu dezynfekcyjnego

Prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie dozownika płynu dezynfekcyjnego automatycznego dla którego wymagania określono w załączniku 2.16. Czy Zamawiający dopuści dozownik renomowanego producenta o wymiarach **wysokość 28,5 cm, szerokość 15 cm, głębokość 9,5 cm.**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania:

- Załącznik nr 2.6_Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.7_Opis Parametrów Technicznych Szafa do suszenia narzędzi_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.11_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.8_Opis Parametrów Technicznych Myjnia-dezynfektor 15 tac DIN_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.9_Opis Parametrów Technicznych komplet wyposażenia dla 6 myjni_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.18_Opis Parametrów Technicznych Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.49_Opis Parametrów Technicznych Kosze sterylizacyjne ze stali kwasoodpornej_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.54_Opis Parametrów Technicznych Regał azurowy_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.56_Opis Parametrów Technicznych Stelaż na wózki wsadowe myjni_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.59_Opis Parametrów Technicznych kosze sterylizacyjne ze stali kwasoodpornej_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz asortymentowo-cenowy_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2a do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 3 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego_PO MODYFIKACJI

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) modyfikuje treść SWZ w zakresie Pkt 30 i 31 dot. terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- Termin składania ofert: 27.01.2026 r. do godz. 10.00
- Termin otwarcia ofert: 27.01.2026 r. o godz. 10:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt 25 SWZ – Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.04.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

2026-01-15
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik

SPECJALISTA

Krystian Jan Saks
Rada Prawny
WA - 13940

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Martyniak

2026-01-16

Z-CADYREKTORA
ds. Operacyjnych

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszzkielce.pl

Bartosz Stemplewski

