

EZ/33/2026/ES

Kielce dn. 09.03.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620 ze zm.) na „Zakup i dostawy różnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1620 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 3

Dzień dobry, Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3 - Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z przetwornikiem wyposażony w linię płuczącą z przesuwną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50- 60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzakałaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu. Byliśmy użytkownikami zestawów, niestety nie spełniły one naszych oczekiwań. Dodatkowym utrudnieniem jest podłączanie zestawu do urządzenia monitorującego parametry życiowe, wiąże się to z koniecznością rozbudowy kardiomonitora o dodatkową przystawkę co generuje kolejne koszty.

Pytanie 2

Dot. wzoru umowy Ad par 10 ust. 1 pkt. 2) ppkt. b wzoru umowy

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową– w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,”

Proponowana minimalna wartość kary 100 zł za każdy dzień zwłoki jest nadmiernie wysoka i nieproporcjonalna do wartości zamówienia oraz odbiegająca od standardów przyjętych na rynku



wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie staplera z 35 zszywkami załadowanymi fabrycznie w rozmiarach 7,0mm x 4,2mm, grubość 0,6mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie narzędzia do usuwania zszywek kompatybilnego ze staplerem z pozycji 1, odpornego na uszkodzenia, silne i wytrzymałe szczęki?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 3.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy zamawiający wymaga w ramach pozycji nr 2 zaoferowania również kaniul asymetrycznych serii Duet, występujących w analogicznych rozmiarach? Kaniule serii DUET posiadają asymetryczne noski, które generując wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, umożliwiają dodatkowe oczyszczanie anatomicznej przestrzeni martwej z CO₂ oraz poprzez redukcję hałasu poprawiają komfort pacjenta, a co za tym idzie zwiększają możliwości zastosowania terapii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z PUR, posiadający 6 pasków radiocieniujących. Skrzydełka oraz samodomykający się korek portu do wstrzyknięć kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli. Wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. Koreczek luer-lock w wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Sterylna. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiary wg potrzeb Zamawiającego:


- G14 (2,1mm)dł. 45mm, przepływ 305ml/min,
- G16 (1,7mm)dł. 45mm, przepływ 200ml/min,
- G17 (1,5mm)dł. 45mm, przepływ 142ml/min,
- G18 (1,3mm)dł. 45mm, przepływ 100ml/min,
- G20 (1,1mm)dł. 32mm, przepływ 61ml/min,
- G22 (0,9mm)dł.25mm, przepływ 36ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?




Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do usuwania zszywek z poniższego zdjęcia o wymiarach ok. 10cm długości oraz 5,5cm szerokości:

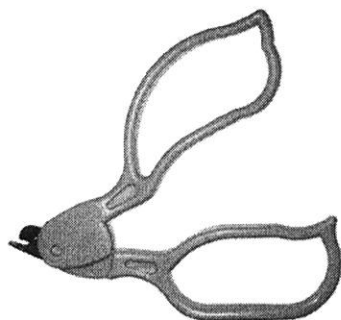

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że urządzenie będzie kompatybilne ze zszywkami z pozycji 1.

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z linii do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem Foleya, a systemem do godzinowej zbiórki moczu. linia pomiarowa wyskalowana w mmHg, czas użycia do 7 dni) oraz osobno pakowanego worka do godzinowej zbiórki moczu wykonanego z medycznego PCV o pojemności 2000 ml, skalowany co 50 ml od 100 ml do 2000 ml, z zastawką antyzwrotną, z drenem o długości 120 cm zakończonym stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką, worek wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek moczu oraz zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia, filtr hydrofobowy znajdujący się w worku i komorze, komora kroplowa o pojemności 500ml skalowana co 1 ml do 50 ml oraz co 5 ml od 50 ml do 500 ml, worek wyposażony w uniwersalny, zintegrowany wieszak, bezlateksowy, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu ?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści - Jednorazowy stapler skórny, sterylny: wyposażony w 35 zszywek, w przezierny magazynek z czytelnym wskaźnikiem zużycia zszywek, posiadający wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany. Zszywki wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte teflonem dla ułatwienia penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany, wymiary zszywki: 6,9 mm x 4,2 mm i grubości zszywki 0,58 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści - Przyrząd do zdejmowania zszywek jednorazowego użytku. Po zamknięciu w otwór (ucho) ekstraktora wchodzi dziubek urządzenia usuwający zszywkę. Uchwyt urządzenia tak jak w imadle chirurgicznym, przyrząd kompatybilny z rozmiarem zszywek z poz. 1?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 10.

Pytanie 12

Dot. wzoru umowy § 10 ust.1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust.1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie;

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie;

d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcznym okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 50,00 zł za stwierdzone uchybienie;

Odpowiedź: Nie, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.

Pytanie 13

Dot. wzoru umowy


Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przysyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przysyłane z adresu e-mail _____ na adres e-mail: _____.]

Odpowiedź: Nie, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 7



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej brutto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku w formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2 do SWZ, przy czym cena w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygnatura akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacji ceny wynikowej, a nie ceną transakcji”.

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania zwracamy się z prośbą o umożliwienie wyceny za opakowanie brutto. Wykonawca dokona przeliczenia ilości sztuk na opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Przychylenie się do prośby Wykonawcy będzie miało również istotny wpływ na Zamawiającego i Wykonawcę na etapie realizacji umowy. Zastosowanie ceny za opakowanie brutto zlikwiduje prawdopodobieństwo rozbieżności pomiędzy fakturą otrzymaną przez Zamawiającego, a formularzem cenowym.

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 14.

Pytanie 16

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: „W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.


Pytanie 17

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.

Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



Pytanie 18

Dot. wzoru umowy §10

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację postanowień dotyczących naliczania kar umownych. Proponujemy, aby kary były naliczane za każdy dzień roboczy zwłoki. Naliczanie kar za dni robocze jest bardziej adekwatne do rzeczywistego harmonogramu prac i uwzględnia faktyczne możliwości wykonawcze Wykonawcy. W dni ustawowo wolne od pracy oraz weekendy, realizacja zamówienia może być ograniczona lub niemożliwa, co nie wynika z zaniedbania Wykonawcy, lecz z obowiązujących przepisów prawa pracy. Taka zmiana pozwoli na bardziej sprawiedliwe i proporcjonalne podejście do kwestii odpowiedzialności kontraktowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 19

Dot. wzoru umowy §10 ust. 1 pkt. 1 lit. b-d

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację postanowień dotyczących naliczania kar umownych. Proponujemy zmianę wysokości naliczanej kary ze 100,00 zł na 50 zł za każdy dzień roboczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 20

Dot. wzoru umowy §10 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30 % wartości niezrealizowanej części umowy”. Krzywdzącym jest, aby Wykonawca ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania jedynie 30% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 21

Dot. Pakietu nr 7

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 1 kaniuli bezpiecznej posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Bezbarwne skrzydełka oraz samodomykający się korek portu do wstrzyknięć kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Koreczek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Opakowanie typu blister pack z łatwym otwieraniem.

Rozmiary wg potrzeb Zamawiającego:


- G14 (2,0mm) dł.45mm, przepływ 270ml/min.
- G16 (1,8mm) dł. 45mm, przepływ 236ml/min.
- G17 (1,5mm) dł. 45mm, przepływ 133ml/min.
- G18 (1,3mm) dł. 32mm, przepływ 103ml/min.
- G20 (1,1mm) dł.32mm, przepływ 67ml/min.
- G22 (0,9mm) dł.25mm, przepływ 42ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Pytanie 22

Dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycji 1 kaniulę 17G 1.5mm dł. 45mm przepływ 140ml/min.? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 23

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1


Jednorazowy stapler skórny, ergonomiczna rękojeść z wyprofilowaniem na palce, z oznaczeniem środka dla perfekcyjnych szwów, dobrze widoczne zszywki w przeziernym magazynku z oznaczeniem ilości pozostałych zszywek, gotowy do użycia stapler zawierający 35 zszywek załadowanych fabrycznie. Rozmiar zszywki 7,3x4,0mm, grubość 0,58mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Ekstraktor jednorazowego użytku do zdejmowania zszywek skórnych metalowych.

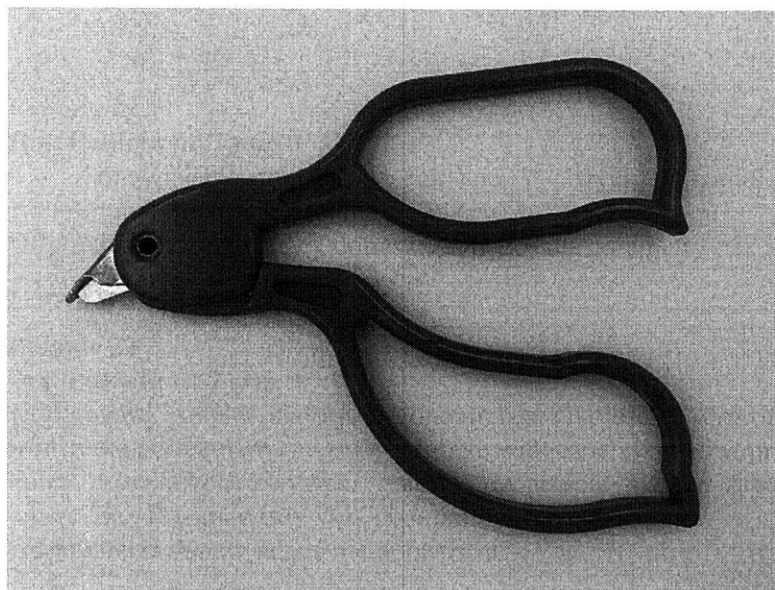

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 23.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwasniewska

09-03-2026

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny

09-03-2026

2026-03-09
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Martyniak

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor

Dział Zamówień Publicznych
Z-CA DYREKTORA ds. Operacyjnych
tel. 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.stefanska@wszzkielce.pl
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Bartosz Stemplewski

09-03-2026

